



Příloha č. 3 ZD

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1. Prodávající: firma Z TECHNIK s.r.o.

se sídlem: Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10
(přesný název a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku)

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 242801

Zastoupená: Ing. Miroslavem Šoulákem, jednatelem

IČO: 04115490

DIČ: CZ04115490

Bankovní spojení: Oberbank AG

č.úctu: 2181117281/8040

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace

se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446

Zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou

IČO: 00842001

DIČ: CZ 00842001

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

č.úctu: 9200529604/0600

(dále jen „kupující“)

(společně pak jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty**“ zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a jeho prováděcími předpisy a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, výzva č. 31 v rámci projektu „**Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP**“ (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/ 0001326),

spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodání **zdravotnických prostředků**:
 - **2 ks parních sterilizátorů dvoudvěřových,**
 - **1 ks parního sterilizátoru jednodvěřového a**
 - **2 ks mycích a dezinfekčních automatů**(dále jen souhrnně „zařízení“) včetně dopravy do sídla kupujícího, montáže – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu dle platné legislativy a také demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího vybavení centrální sterilizace ve stejném rozsahu, jako je rozsah předmětu smlouvy. Součástí dodávky je i poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců a dále provádění periodických bezpečnostně technických kontrol i provádění odborné údržby (preventivní údržby a oprav) v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a v souladu s doporučením výrobce po celou dobu trvání záruky (dále jen souhrnně „předmět smlouvy“).
2. Specifikace předmětu smlouvy je uvedena zejména v přílohách č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Předmět smlouvy je dán:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávky: „**Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty**“ vedené ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-002695 a u kupujícího pod ev. č. 03/18/VZ (dále jen „ZD“) a
 - b) písemnou nabídkou prodávajícího podanou v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky.

Čl. II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat a odevzdat kupujícímu nové, nepoužité zařízení specifikované v čl. I této smlouvy v požadované kvalitě, množství, řádně a včas a převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení.
2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny legislativou předepsané požadavky na kvalifikaci i ostatní požadavky, které jsou nutné k plnění předmětu smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že zařízení splňuje a po dobu záruky za jakost bude splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a požadavky platné legislativou pro tuto oblast zejména:
 - se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým

prostředků č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaného zařízení v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho prováděcími předpisy, dodané zařízení zprovoznit a provést instruktáž ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb. Instruktáž věcně příslušných osob bude zdokumentována písemným protokolem, vyhotoveným prodávajícím.
5. Prodávající se zavazuje provést v souladu s platnou legislativou demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího vybavení centrální sterilizace ve stejném rozsahu, jako je rozsah předmětu smlouvy.
6. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje:
- a) provádět periodické bezpečnostně technické kontroly (PBTK) v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce včetně předávání protokolů z nich kupujícímu ve lhůtě do 2 týdnů od jejich dokončení a to po celou dobu trvání záruky;
 - b) provádět preventivní odbornou údržbu a opravy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce včetně provádění oprav a to po celou dobu trvání záruky;
 - c) sledovat dodržování zákonem a výrobcem stanovených termínů PBTK a odborné údržby a to po celou dobu trvání záruky a
 - d) poskytovat kupujícímu garanci dostupnosti autorizovaného servisu po dobu životnosti přístroje.

Pokud konkrétní část zařízení dle právních předpisů či doporučení výrobce provádění shora uvedených činností (nad rámec plnění povinností ze záruky či z odpovědnosti za vady) nevyžadují, tak se tyto další závazky prodávajícího vůči nim neuplatňují.

Uvedené činnosti rovněž tvoří resp. se považují za součást plnění dle této smlouvy v době sjednané záruky za jakost a prodávající nemá za jejich provádění nárok na jakékoli zvláštní finanční či obdobné kompenzace.

7. Prodávající se po dobu životnosti dodaného předmětu smlouvy zavazuje bezplatně poskytnout nezbytnou součinnost v případě změny informačního systému pro operační sály a centrální sterilizace.
8. Vzhledem k tomu, že plnění z této smlouvy je většinou financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu je prodávající povinen:
- a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu pod reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326 včetně všech účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší a

- b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Kupující se zavazuje uvedené zařízení od prodávajícího převzít za předpokladu, že zařízení bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Čl. III.

Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že předmět smlouvy uvedený v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za tuto kupní cenu:

8 019 000,00 Kč bez DPH

(slovy: osmmiliónůdevatenácttisíc Kč)

DPH: 1 683 990,00 Kč (sazba DPH: 21 %)

9 702 990,00 Kč s DPH

(slovy: devětmiliónůsedmsetdvatisícdevětsetdevadesát Kč)

Rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Uvedená kupní cena zahrnuje všechny náklady za kompletní realizaci dodávky i za ostatní činnosti, sjednané touto smlouvou, a to tak, že je konečná a pevná.
3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Kupující je plátcem DPH.
4. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Kupující zaplatí kupní cenu za zařízení na základě faktury, a to převodem uvedené částky na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Prodávající je oprávněn vystavit a doručit fakturu za předmět této smlouvy až poté, co předmět této smlouvy řádně

dodá a předá do sídla kupujícího v souladu s touto smlouvou a současně předá kupujícímu veškeré doklady nutné, potřebné a vhodné k řádnému, bezpečnému a nerušenému užívání předmětu této smlouvy. Vystavená faktura vedle náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitostí obchodní listiny podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku, musí obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného předávacího protokolu), číslo faktury, datum splatnosti, číslo projektu (v tomto případě je to CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326) a případné další zákonné náležitosti. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem zaměstnance prodávajícího ji vystavit.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené výše v odstavci 5, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nové bezvadné faktury kupujícímu.
7. Smluvní splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Smluvní strany prohlašují, že splatnost daňového dokladu je, s ohledem na zavedený organizační systém kupujícího zohledňující financování zdravotními pojišťovnami, pro obě smluvní strany spravedlivá.
8. Podmínkou úhrady faktury kupujícím je předání a převzetí zařízení, jeho zprovoznění a provedení zaškolení obsluhy.
9. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
10. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
11. Prodávající se zavazuje zlikvidovat veškerý obalový materiál, který bude dodán se zařízením.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu během realizace předmětu smlouvy žádné zálohové platby.

Čl. IV.

Doba a místo dodání zařízení, převod vlastnictví

1. Zařízení bude dodáno dopravními prostředky prodávajícího. Kupní cena zahrnuje i náklady za dopravu dle čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. Zařízení bude dodáno do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na **pracoviště centrální sterilizace (parní sterilizátory dvoudvěřové a mycí a dezinfekční automaty) a na centrální operační sály zadavatele (parní sterilizátor jednodvěřový).**

3. Zařízení je pokládáno za předané a převzaté podpisem příslušného zaměstnance prodávajícího a kupujícího na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Přílohou předávacího protokolu bude protokol o zaškolení obsluhy.
4. Zaměstnanec kupujícího, který zařízení od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodané zařízení zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo zařízení vykazuje zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně sdělit. Pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo zařízení znehodnocovaly, a to i přesto, že zařízení je funkční, má kupující právo takovouto dodávku zařízení odmítnout.
5. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k dodanému zařízení na kupujícího po provedení instalace, zaškolení obsluhy a podepsání předávacího protokolu. Nedílnou součástí převodu vlastnického práva tvoří předání dokladů k dodanému zařízení dle čl. V této smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje zařízení dodat a předat kupujícímu nejpozději do **12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. IX. odst. 10 níže.** Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu, to je po zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy.
7. Nebezpečí škody na zařízení přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu.
8. Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

Čl. V.

Doklady vztahující se k zařízení

1. Spolu se zařízením je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání zařízení a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, prohlášení o shodě event. certifikát CE a dále pak doklady osvědčující technické požadavky podle zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI.

Odpovědnost prodávajícího za vady zařízení

1. Prodávající poskytuje na zařízení bezplatnou záruku ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku po dobu **24 měsíců** od data předání zařízení.
2. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zařízení bude po dobu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu legislativy, technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, které má dané zařízení splňovat a které se na dané zařízení vztahují.

3. Prodávající neodpovídá za vady zařízení, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom, jakým způsobem je třeba se zařízením zacházet.
4. Zjevné vady zařízení, tedy vady, které lze zjistit při převzetí zařízení kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností.
5. Vady, které lze zjistit až po dodání zařízení, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění (kontaktní email viz článek IX. odst. 2). Reklamace bude obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje. Kupující dále uvede, které právo dle čl. VI. odst. 6 si zvolil.
6. V případě vadného plnění, které je považováno za podstatné porušení smlouvy, či reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a) právo žádat dodání nového bezvadného plnění,
 - b) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - c) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,
 - d) právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o vady stejného druhu zařízení nebo o vadu, která brání řádnému užívání a v náhradním termínu nebylo dodáno nové bezvadné zařízení.
7. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. Prodávající garantuje zprovoznění zařízení (provedení opravy a předání funkčního zařízení) v záruční době do 3 pracovních dnů od nahlášení vady v pracovní den (nástup servisní organizace prodávajícího do 24 hodin od nahlášení vady). V případě náročnější opravy delší než 3 pracovní dny od nahlášení (např. při nemožnosti zajištění dodávky náhradních dílů) kupující požaduje ve vhodných případech zapůjčení odpovídajícího náhradního přístroje event. jeho části na dobu opravy, tak, aby přístroj byl plně funkční.
9. Prodávající si je vědom toho, že nesmí prodávat zdravotnické přístroje, existuje-li důvodné podezření, že je jejich používáním ohroženo zdraví a bezpečnost uživatelů nebo třetích osob, a to vzhledem k poznatkům lékařské vědy.
10. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat pravidelnými kontrolami dodané zařízení - zdravotnický přístroj v takovém stavu, aby byla po dobu jeho použitelnosti (dle potřeby kupujícího) zaručena jeho funkčnost a bezpečnost.
11. Kontaktní údaje pro provádění servisních služeb:

Název servisní organizace: BMT Medical Technology s.r.o.

Jméno kontaktní osoby: Jan Krček, vedoucí servisu

Adresa: Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno

Tel: +420 545 211 750

Email: jan.krcek@bmt.cz

Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit i v následujících případech:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou zařízení déle než jeden měsíc,
 - b) prodávající není schopen dodat předmět smlouvy uvedený v článku I. této smlouvy
 - c) zařízení vykazuje opakující se vady,
 - d) zařízení vykazuje podstatnou vadu, pro niž nelze zařízení užívat a prodávající takovouto vadu neodstranil do 14 dnů ode dne reklamace.
2. Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit, pakliže v důsledku rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nebo příslušných kontrolních orgánů nebude moci zařízení používat, protože jeho užívání ohrožuje bezpečnost a zdraví uživatele nebo třetích osob.
3. Proávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury déle než 2 měsíce.
4. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu
5. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoliv.

Pokud důvody odstoupení od smlouvy neuznává, musí uvést, v čem spatřuje nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.

Pokud druhá smluvní strana odstoupení od smlouvy uzná, provedou smluvní strany inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Dodané a nezaplacené zařízení bude vráceno bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zařízení o více jak 10 kalendářních dnů, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,15% z celkové hodnoty předmětu smlouvy za každý den prodlení.

3. V případě, že smluvní straně vznikne škoda v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, má druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši vzniklé škody.
4. V případě, že prodávající nedodrží nástupní termín na opravu dle čl. VI odst. 8 této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% kupní ceny za každých započatých 24 hodin.
5. Pokud nebude závada odstraněna dle čl. VI odst. 8 této smlouvy a nedojde v tomto termínu k zapůjčení náhradního zařízení – přístroje (event. jeho části), zaplatí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% kupní ceny za každých započatých 24 hodin.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

1. Kontaktní údaje kupujícího ve věcech vyplývajících z této smlouvy:

Technické oddělení – sídlo kupujícího

tel. 566 801 608/597

email: technicke@nnm.cz

2. Kontaktní údaje prodávajícího ve věcech vyplývajících z této smlouvy:

Ing. Miroslav Šoulák

tel.: 602 759 167

email: msoulak@ztechnik.cz

3. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
4. Prodávající prohlašuje, že věcné plnění této smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
5. Kupující si vyhrazuje možnost úpravy termínu plnění předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na jeho straně, a to po předchozí dohodě s prodávajícím.
6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejich členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně příslušných soudů. Smluvní strany se dále dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami

plynoucích z této smlouvy je místně příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.

7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující a splnění této povinnosti doloží prodávajícímu. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
9. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy případně i podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
11. Všechna předcházející ujednání, týkající se předmětu smlouvy jsou po podpisu této smlouvy neplatná.
12. Veškerá další ujednání, změny či doplnění smlouvy mohou být učiněna jen formou písemného číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
13. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
14. Pohledávky vyplývající z této smlouvy, může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
15. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
16. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Novém Městě na Moravě dne 28.5.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

V Praze dne 11.5.2018

Z TECHNIK s.r.o.
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10
IČ: 04115490 DIČ: CZ04115490

Ing. Miroslav Šoulák
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis kupní ceny

Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 3 – Popis předmětu smlouvy

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 – Předávací protokol /vzor/

Příloha č. 6 – Pravidla součinnosti s úsekem informatiky kupujícího

Příloha č. 7 -Pravidla pro zřízení a používání vzdáleného přístupu do počítačové sítě Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Rozpis kupní ceny

položka	ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH
parní sterilizátor STERIVAP® HP 6612-2 ED obslužný software DP 3.5 CZ 4 ks transportní vozík pro poloviční hloubku komory 2 ks zavážecí vozík pro poloviční hloubku komory 1 ks zavážecí vozík pro plnou hloubku komory	2	1 439 000,00 Kč	2 878 000,00 Kč
parní sterilizátor UNISTERI HP® 636-1 ED obslužný software DP 3.5 CZ	1	941 000,00 Kč	941 000,00 Kč
mycí a desínkeční automat PG 8528 EL BO AV OXI / ORTHO vestavěná tiskárna sušící agregát kondenzátor par podlahová bezpečnostní vana obslužný software DP 3.5 CZ 2 ks zavážecí vozíky pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů mycí koš s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít standardní velikosti mycí koš k uložení min. 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík 18 ks - mycí DIN síta standardní velikosti injektorový vozík k uložení dutých nástrojů do 6 modulových nástavců s integrovanými tryskami a adaptéry (s přípojkou pro horkovzdušné sušení), kapacita modulových nástavců až na 3 miniinvazivní chirurgické sady	1	2 188 984,00 Kč	2 188 984,00 Kč
mycí a desínkeční automat PG 8528 EL BO AV vestavěná tiskárna sušící agregát kondenzátor par podlahová bezpečnostní vana obslužný software DP 3.5 CZ 2 ks zavážecí vozíky pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů mycí koš s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít standardní velikosti mycí koš k uložení min. 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík 18 ks - mycí DIN síta standardní velikosti mycí koš včetně nástavců - 20 párů operační obuvi	1	2 011 016,00 Kč	2 011 016,00 Kč

Cena celkem bez DPH

8 019 000,00 Kč

DPH (21%)

1 683 990,00 Kč

Cena celkem s DPH

9 702 990,00 Kč

Z TECHNIKA s.r.o.
 Bohdalecká 1490/25
 101 00 Zlín A 10
 IČ: 04115490 DIČ: CZ04115490



Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty
<i>druh zadávacího řízení:</i>	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:</i>	Z2018-002695
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	03/18/VZ

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení pracoviště centrální sterilizace zadavatele, a to dodávka zdravotnických prostředků:

- 2 ks parních sterilizátorů dvoudvěřových,
- 1 ks parního sterilizátoru jednodvěřového a
- 2 ks mycích a dezinfekčních automatů

Předmět veřejné zakázky bude používán na pracovišti centrální sterilizace (parní sterilizátory dvoudvěřové a mycí a dezinfekční automaty) a centrálních operačních sálech zadavatele (parní sterilizátor jednodvěřový).

Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu dle platné legislativy a také demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího vybavení centrální sterilizace ve stejném rozsahu, jako je rozsah předmětu zakázky. Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců a provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a v souladu s doporučením výrobce po celou dobu trvání záruky.

1.2 Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované technologie.

1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyločení z účasti v zadávacím řízení.

1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: **nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;**
- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997



Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1.5 Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaného účelu použití předmětu veřejné zakázky.

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní účastník zadávacího řízení)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
1. STERILIZÁTORY PARNÍ – dvoudvěřové – 2 ks					
1.	nové, nepoužité parní dvoudvěřové sterilizátory – <u>2 ks</u>	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
2.	sterilizátory s integrovaným vyvíječem páry	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
3.	sterilizátory určené min. ke sterilizaci nástrojů, textilií, gumy a plastů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
4.	sterilizátory musí splňovat požadavky normy ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a musí být validovatelné dle této normy ¹	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
5.	sterilizátory musí splňovat požadavky normy ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky a musí být validovatelné dle této normy ²	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26

¹ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace.

² V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel



6.	sterilizátory musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	78
7.	objem komory 8 sterilizačních jednotek (STJ)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
8.	vnější rozměry zařízení 1300x1920x1640 mm (š,v,h), platí tolerance +/-10%	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - 1300x1918x1640 mm	26
9.	rozměry transportní cesty max. 1600 x 2000 mm (š x v)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano – 1600x2000 mm	26
10.	příkon sterilizátoru max. 48 <u>52,5kW</u>	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano – 48 kW	26
10a)	jištění sterilizátoru max. 80A (přívodní kabel je 1CYKY 5C x 35')	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 80 A	26
11.	prokládací, hranatá celonerezová tlaková komora s duplikátem	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
12.	motoricky ovládané vertikálně posuvné dveře sterilizační komory s bezpečnostním zajištěním	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
13.	automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
14.	základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv. Vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
15.	integrované odplynění napájecí demineralizované vody (dále jen „DEMI voda“)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
16.	zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
17.	dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
18.	výkonná vývěva dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku min. 13 kPa	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26

povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace.



19.	plně automatické řízení jednotlivých cyklů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
20.	ovládání přes barevný, ergonomický, nastavitelný dotykový displej (velikost min 10") v českém jazyce	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano – velikost displeje 12"	26
21.	vestavěná tiskárna na nakládací straně (tisk protokolu)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
22.	monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (min. čas, teplota, tlak)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
23.	systém pro modifikaci programů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
24.	signalizace poruchových stavů v jednotlivých fázích steril. cyklu na ovládacím displeji v češtině (min. signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
25.	na vyvážecí straně dotykový displej s možností sledování sterilizačního procesu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
26.	vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
27.	rozhraní RS 232	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
28.	kontinuální monitoring přítomnosti vzduchu a nekodenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého steril. programu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
29.	zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
30.	2 ks rám do komory pro zavážecí vozík	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
31.	součástí dodávky nerezová stěna pro usazení a zakrytování přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru pro každý sterilizátor (vlastní servisní dveře pro každý sterilizátor)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
32.	krycí lišty na čistou stranu přístroje	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26



33.	připojení k počítači a ukládání protokolů do paměti PC	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
34.	zajištění funkčního připojení sterilizátoru ke stávající softwarové aplikaci – systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice. ³	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
35.	součástí dodávky obslužný software systému jakosti (např. DP 3.5 CZ, T-DOC, apod.), včetně vzdáleného servisního monitoringu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
36.	integrovaný odpad	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
37.	připojení ke stávajícím mediím: min. upravená voda, studená voda, elektro, odpad	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
38.	provedení instalační a validační zkoušky v souladu s požadavky normy ČSN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky ⁴	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
Vybavení nezbytné pro provoz parních sterilizátorů dvoudvěřových:					
39.	součástí dodávky 8 ks transportních vozíků pro poloviční hloubku komory	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
40.	součástí dodávky 4 ks zavážecích vozíků pro poloviční hloubku komory	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26

³ Poznámka: Zadavatel uvádí konkrétní názvy softwarů pouze z důvodu, aby účastník zadávacího řízení měl informaci, s jakými SW již ve vlastnictví zadavatele musí nabízené řešení účastníka zadávacího řízení bezchybně spolupracovat.

⁴ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům na instalaci a validaci dle dané normy.



41.	součástí dodávky 2 ks zavážecích vozíků pro plnou hloubku komory	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	26
<u>2. STERILIZÁTOR PARNÍ – JEDNODVĚŘOVÝ – 1 ks</u>					
42.	nový, nepoužitý parní jedno-dvěřový sterilizátor – <u>1 ks</u>	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
43.	sterilizátor určený min. ke sterilizaci nástrojů, textilů, gumy a plastů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
44.	integrovaný vyvíječ páry	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
45.	sterilizátor musí splňovat požadavky normy ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a musí být validovatelné dle této normy ⁵	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
46.	sterilizátor musí splňovat požadavky normy ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky a musí být validovatelné dle této normy ⁶	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
47.	sterilizátor musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	78

⁵ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy, a to i k procesu validace.

⁶ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy, a to i k procesu validace.



	sociální péče, ve znění pozdějších předpisů				
48.	objem komory 2 sterilizační jednotky (STJ)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
49.	vnější rozměry zařízení 700x970 mm (š x h), platí tolerance +/- 10%, výška max. 1950 mm (viz pol. č. 51)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano – 690x965x 1720 mm	27
50.	rozměry transportní cesty max max. 880 x 1950 mm (š x v)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano – 880x1950 mm	27
51.	příkon sterilizátoru max. 17 <u>20kW</u>	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano – 17 kW	27
52.	jištění sterilizátoru max. 40A	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
53.	jednodvěřová hranatá celonerezová tlaková komora s duplikátem	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
54.	vertikální otevírání dveří nebo otevírání do stran (panty vpravo) s automatickým systémem zavírání/otvírání včetně zatěsnění dveří	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
55.	automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C,	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
56.	základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv. Vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
57.	zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
58.	dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
59.	výkonná vývěva dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku min. 13 kPa	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - tlak 13 kPa	27
60.	plně automatické řízení jednotlivých cyklů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
61.	ovládání přes barevný, dotykový displej (velikost min. 7") v českém jazyce	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - vel. 8,4"	27
62.	vestavěná tiskárna na čelním panelu (tisk protokolu)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
63.	monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (min. čas, teplota, tlak)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
64.	systém pro modifikaci programů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27



65.	signalizace poruchových stavů na ovládacím displeji v češtině (min. signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku); sledování poruch v jednotlivých fázích steril. cyklu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
66.	vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
67.	rozhraní RS 232	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
68.	opatření na úsporu napájecí vody pro vývěvu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
69.	rám do komory + 2 ks nerezových polic	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
70.	boční obkladové nerezové plechy sterilizátoru a horní panel	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
71.	připojení k počítači a ukládání protokolů do paměti PC	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
72.	zajištění funkčního připojení sterilizátoru ke stávající softwarové aplikaci – systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice. ⁷	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
73.	součástí dodávky obslužný software - systému jakosti (např. DP 3.5 CZ, T-DOC, apod.) včetně vzdáleného servisního monitoringu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
74.	provedení instalační a validační zkoušky dle ČSN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky ⁸	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29

⁷ Poznámka: Zadavatel uvádí konkrétní názvy softwarů pouze z důvodu, aby účastník zadávacího řízení měl informaci, s jakými SW již ve vlastnictví zadavatele musí nabízené řešení účastníka zadávacího řízení bezchybně spolupracovat.

⁸ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům na instalaci a validaci dle dané normy.



75.	připojení ke stávajícím mediím: min. upravená voda, studená voda, elektro, odpad,	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	27
3. MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMATY – 2 ks					
76.	nové, nepoužité, prokládací, dvoudveřové mycí a dezinfekční automaty – 2 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
77.	mycí a dezinfekční automaty musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky a musí být validovatelné dle této normy ⁹	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
78.	elektro ohřev, připojení přes stávající jištění C40	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
79.	příkon myčky max. 21 kW	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 20 kW	28
80.	mycí prostor s kapacitou min. 15 mycích DIN sít o velikosti v,š,h 50x250x480 mm (dále jen „Standardní velikost“)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
81.	součástí dodávky nerezová stěna pro usazení a zakrytování přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
82.	mycí prostor vybaven min. dvěma nerezovými mycími rameny	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
83.	elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídicí jednotka (min. 64 programů) s možností tvorby vlastních programů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 64 programů	28
84.	dotykový grafický textový displej, v češtině	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
85.	komunikace na displeji a informace o průběhu mycího cyklu v českém jazyce	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
86.	vestavěná tiskárna na „čisté straně“	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28

⁹ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace.



87.	výstup pro dokumentaci průběhu mycího cyklu (ethernet) s možností tisku a připojení na PC	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
88.	zajištění funkčního připojení sterilizátoru ke stávající softwarové aplikaci – systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice. ¹⁰	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
89.	obslužný software - systému jakosti (např. DP 3.5 CZ, T-DOC, apod.), včetně vzdáleného servisního monitoringu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
90.	mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
91.	min. jeden přístroj s mycím a dezinfekčním programem na silně znečištěné instrumentárium (např. s použitím peroxidu vodíku)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano počet ks 1.	28
92.	termická i chemotermická dezinfekce v parametrech uvedených ve Vyhlášce č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	79
93.	celonerezová dvířka nebo celoskleněná dvířka s osvětlením vnitřního prostoru mycí komory; vertikální motorický posun dveří, během mycího cyklu blokován	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
94.	systém přímého připojení pro různé koše s automatickým definováním programu podle magnetického záznamu nebo čárového kódu na koších	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
95.	elektronická kontrola otáčení všech ostřikovacích ramen	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
96.	systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
97.	3-násobná filtrace mycího roztoku	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28

¹⁰ Poznámka: Zadavatel uvádí konkrétní názvy softwarů pouze z důvodu, aby účastník zadávacího řízení měl informaci, s jakými SW již ve vlastnictví zadavatele musí nabízené řešení účastníka zadávacího řízení bezchybně spolupracovat.



98.	dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli, s tepelnou a zvukovou izolací	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
99.	vnější rozměry přístroje - v,š,h 2420x1150x950 mm (tolerance +/- 10%)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano-2420x1150x870 mm	28
100	oběhové čerpadlo min. o výkonu 1000 lit./min. nebo řešení se dvěma oběhovými čerpadly o celkovém výkonu min. 1000 lit./min.	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano výkon. 600+400 lit/min	28
101	4 vestavěná dávkovací čerpadla na mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
102	kontrola dávkování tekutých médií	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
103	vestavěný kondenzátor par s výměníkem tepla	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
104	vestavěný horkovzdušný sušicí agregát s aktivním HEPA filtrem třídy EU 13 (stupeň filtrace min. 99,992%), doba cyklu včetně sušení do 60 min.	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
105	boiler pro přehřátí DEMI vody	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
106	měření vodivosti oplachových lázní s DEMI vodou	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
107	provedení instalační a validační zkoušky dle požadavků normy ČSN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky ¹¹	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	29
108	připojení ke stávajícím mediím: horní vývody pro studenou (změkčenou), DEMI vodu a chladicí vodu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
109	připojení ke stávajícím mediím: elektro, odpad	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28

¹¹ V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům na instalaci a validaci dle požadavků dané normy



110	2 ks bezpečnostní základová nerez vana součástí dodávky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
111	součástí dodávky 1 ks injektorový vozík k uložení dutých nástrojů do 6 modulových nástavců s integrovanými tryskami a adaptéry (s přípojkou pro horkovzdušné sušení), kapacita modulových nástavců až na 3 miniinvazivní chirurgické sady	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
112	součástí dodávky 1 ks mycí koš k uložení min. 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík (v,š,h kontejneru 150x300x600 mm)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
<u>Vybavení nezbytné pro provoz mycích a dezinfekčních automatů:</u>					
113	součástí dodávky 4 ks zavážecích vozíků pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
114	součástí dodávky 2 ks mycí koše s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít Standardní velikosti	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
115	součástí dodávky 1 ks mycí koš k uložení min. 6 DIN sít Standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík (v,š,h kontejneru 150x300x600 mm)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
116	36 ks mycích DIN sít Standardní velikosti součástí dodávky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28
117	součástí dodávky 1 ks mycí koš včetně nástavců min. 20 párů operační obuvi	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	28



1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
 - zajištění pravidelných externích validací/kalibrací (kontrola elektrických, mechanických parametrů, kontrola regulace a homogenity teploty);
 - zajištění vypracování validačních protokolů včetně teplotních map
 - účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11. 1 písm. b) ZD/;
 - v případě, že dodavatel nabídne plnění s rovnocenným řešením ve vztahu k požadavkům č. 4, 5, 38, 45, 46, 74, 77 a 107 uvedeným výše v tabulce, v rámci nabídky povinně předloží materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům uvedeným v daných položkách (viz podrobné popisy u jednotlivých položek).

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 11.5.2018

Z TECHNIK s.r.o.
Bohdalecká 1490/25
106 00 Praha 10
IČ: 04115490 DIČ: CZ04115490

.....
Ing. Miroslav Šoulák, jednatel

Předmětem dodávky v rámci veřejné zakázky „Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty jsou:


1. 2 ks nových, nepoužitých parních dvoudveřových sterilizátorů STERIVAP® HP 6612-2 ED s objemem komory 8 sterilizačních jednotek, s integrovaným vyvíječem par. Sterilizátory splňují požadavky norem ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (doloženo prohlášením o shodě) a jsou dle těchto norem validovatelné. Sterilizátory jsou určené ke sterilizaci nástrojů, textilu, gumy, plastů a roztoků. Vnější rozměry přístroje jsou 1300x1918x1640 mm, hmotnost 1400 kg. V návaznosti na rozměry je možný transport po transportní cestě s rozměry max. 1600 x 2000 mm. Max. příkon sterilizátoru je 48 kW, jištění 80A. Přístroj bude připojen k počítači (součástí přístroje rozhraní RS232) s možností ukládání protokolů do paměti PC. Součástí dodávky bude nerezová stěna pro usazení a zakrytování přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru pro každý sterilizátor, krycí lišty na čistou stranu přístroje, 8 ks transportních vozíků pro poloviční hloubku komory, 4 ks zavážecích vozíků pro poloviční hloubku komory, 2 ks zavážecích vozíků pro plnou hloubku komory.

Sterilizátory budou připojeny ke stávajícím mediím: upravená voda, studená voda, elektro, odpad.

Sterilizátory mají prokládací, hranatou celonerezovou tlakovou komoru s duplikátem; motoricky ovládané vertikálně posuvné dveře sterilizační komory s bezpečnostním zajištěním; integrované odplynění napájecí demineralizované vody; zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr; dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci; výkonnou vývěvu dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku - 13 kPa; plně automatické řízení jednotlivých cyklů; ovládání přes barevný, ergonomický, nastavitelný dotykový displej (velikost 12") v českém jazyce; vestavěnou tiskárnu na nakládací straně; monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (čas, teplota, tlak); systém pro modifikaci programů; signalizaci poruchových stavů v jednotlivých fázích sterilizačního cyklu na ovládacím displeji v češtině (signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku); na vyvážecí straně dotykový displej (velikost 5,7") s možností sledování sterilizačního procesu; vestavěnou autodiagnostiku a soubor servisních programů; kontinuální monitoring přítomnosti vzduchu a nekodenovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu; zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu; 2 ks rámu do komory pro zavážecí vozík; integrovaný odpad.

Sterilizátory mají automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C; základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv. vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test)

Technické parametry přístroje jsou též uvedeny v produktovém listu výrobku.

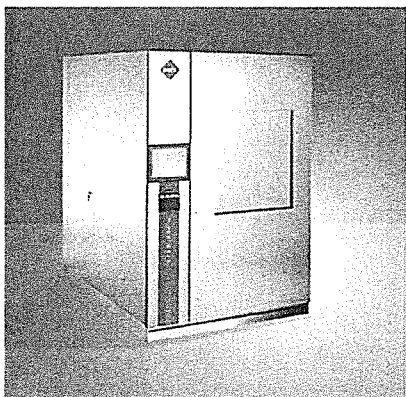

2. 1 ks nového, nepoužitého parního jednodveřového sterilizátoru UNISTERI HP® 636-1 ED s objemem komory 2 sterilizačních jednotek, s integrovaným vyvíječem pár. Sterilizátor splňuje požadavky norem ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (doloženo prohlášením o shodě) a jsou dle těchto norem validovatelný. Sterilizátor je určený ke sterilizaci nástrojů, textilu, gumy, plastů a roztoků. Vnější rozměry přístroje jsou 690x965x1720 mm. Hmotnost 520 kg. V návaznosti na rozměry je možný transport po transportní cestě s rozměry max. 880 x 1950 mm. Max. příkon sterilizátoru je 17 kW, jištění 25A. Přístroj bude připojen k počítači (součástí přístroje rozhraní RS232) s možností ukládání protokolů do paměti PC. Součástí dodávky budou boční obkladové nerezové plechy sterilizátoru a horní panel.

Sterilizátor bude připojen ke stávajícím mediím: upravená voda, studená voda, elektro, odpad. Sterilizátor má jednodveřovou hranatou celonerezovou tlakovou komoru s duplikátem; dveře s otevíráním do stran s automatickým systémem zavírání/otvírání včetně zatěsnění dveří; zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr; dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci; výkonnou vývěvu dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku - 13 kPa; plně automatické řízení jednotlivých cyklů; ovládání přes barevný, dotykový displej (velikost 8,4") v českém jazyce; vestavěnou tiskárnu na čelním panelu (tisk protokolu); monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (min. čas, teplota, tlak); systém pro modifikaci programů; signalizaci poruchových stavů na ovládacím displeji v češtině (signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku); sledování poruch v jednotlivých fázích sterilizačního cyklu; vestavěnou autodiagnostiku a soubor servisních programů; opatření na úsporu napájecí vody pro vývěvu; rám do komory + 2 ks nerezových polic

Sterilizátor má automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C; základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv. vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test)

Technické parametry přístroje jsou též uvedeny v produktovém listu výrobku.




3. 2 ks nových, nepoužitých prokládacích, dvoudveřových mycích a dezinfekčních automatů Miele PG 8528 EL BO AV s mycím prostorem s kapacitou 15 mycích DIN sít. Mycí a dezinfekční automaty splňují požadavky normy ČSN EN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky (doloženo prohlášením o shodě) a jsou dle této normy validovatelné. Jeden z přístrojů v provedení OXI/ORTHO - s mycím a dezinfekčním programem na silně znečištěné instrumentárium. Vnější rozměry přístroje jsou 2420x1150x870 mm, hmotnost 386 kg. Max. příkon přístroje s elektro ohřevem je 20 kW, jistič 32A. Přístroj bude připojen k počítači pro dokumentaci průběhu mycího cyklu (ethernet) s možností tisku. Součástí dodávky bude nerezová stěna pro usazení a zakrytí přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru, 2 ks bezpečnostní základové nerezové vany a dále 1 ks injektorový vozík k uložení dutých nástrojů do 6 modulových nástavců s integrovanými tryskami a adaptéry (s přípojkou pro horkovzdušné sušení), kapacita modulových nástavců až na 3 miniinvasivní chirurgické sady, 2 ks mycí koš k uložení 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení 3 nízkých kontejnerů vč. vík, 4 ks zavážecích vozíků pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů, 2 ks mycích košů s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít standardní velikosti, 36 ks mycích DIN sít, 1 ks mycí koš včetně nástavců na 20 párů operační obuvi.

Mycí a dezinfekční automaty budou připojeny ke stávajícím mediím: horní vývody pro studenou (změkčenou), DEMI vodu a chladicí vodu; elektro a odpad.

Mycí a dezinfekční automaty mají mycí prostor vybaven dvěma nerezovými mycími rameny; elektronickou, volně programovatelnou mikroprocesorovou řídicí jednotku (64 programů vč. servisních) s možností tvorby vlastních programů; dotykový grafický textový displej, v češtině; komunikaci na displeji a informace o průběhu mycího cyklu v českém jazyce; vestavěnou tiskárnu na „čisté straně“; mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické; celoskleněná dvířka s osvětlením vnitřního prostoru mycí komory; vertikální motorický posun dveří, během mycího cyklu blokován; systém přímého připojení pro různé koše s automatickým definováním programu podle magnetického záznamu; elektronickou kontrolu otáčení všech ostřikovacích ramen; systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu; 3-násobnou filtraci mycího roztoku; dvouplášťovou konstrukce z nerezové oceli, s tepelnou a zvukovou izolací; dvě oběhová čerpadla o celkovém výkonu 1000 lit./min. (400 + 600 lit./min.); 4 vestavěná dávkovací čerpadla na mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky; kontrolu dávkování tekutých médií; vestavěný kondenzátor par s výměníkem tepla; vestavěný horkovzdušný sušící agregát s aktivním HEPA filtrem třídy EU 13 (stupeň filtrace 99,992%), dobou cyklu včetně sušení do 60 min.; boiler pro předehřátí DEMI vod; měření vodivosti oplachových lázní s DEMI vodou

Technické parametry přístroje jsou též uvedeny v produktovém listu výrobku.

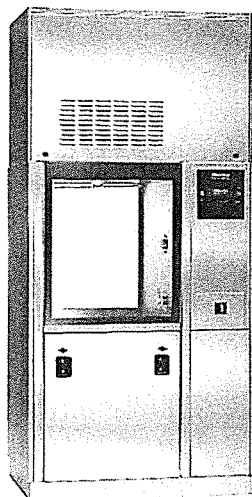

Sterilizátory i dezinfekční automaty je možno připojit ke stávající softwarové aplikaci – systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice. Součástí dodávky sterilizátorů a mycích a dezinfekčních automatů je obslužný software - systému jakosti DP 3.5 CZ včetně vzdáleného servisního monitoringu.

Součástí dodávky parních sterilizátorů bude provedení instalační a validační zkoušky dle ČSN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky; součástí dodávky mycích a dezinfekčních automatů bude provedení instalační a validační zkoušky dle požadavků normy ČSN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.

Seznam poddodavatelů

<i>Zadavatel:</i>		Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace			
<i>sídlo zadavatele:</i>		Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě			
<i>zastoupený:</i>		JUDr. Věrou Palečkovou			
<i>IČO:</i>		00842001			
<i>název VZ:</i>		Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty			
<i>druh zadávacího řízení:</i>		nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení			
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>		Z2018-002695			
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>		03/18/VZ			
PODDODAVATEL		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]	
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Tel./fax: E-mail:	BMT Medical Technology s.r.o. Cejl 157/50, 602 00 Brno 46346996 Ing. Milan Krajcar 545537111/545211750 mail@bmt.cz	dodávka, instalace, servisní zabezpečení	40	ne
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Tel./fax: E-mail:	Miele, spol. s r.o. Holandská 4 639 00 Brno 18829503 Mgr. Tomáš Abraham, MBA 543553111/543553149 info@miele.cz	dodávka, instalace, servisní zabezpečení	45	ne

Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +420 566 801 111 email: sekretariat@nnm.cz
Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. xxxxxxxxxxxx

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou xxxxxxxxxxxx.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

Pravidla součinnosti s úsekem informatiky kupujícího (dále jen „ÚI“)


V případě, že předmět smlouvy či jeho části vyžadují zapojení do počítačové sítě prodávajícího, musí být tato činnost prováděna se souhlasem zaměstnance ÚI. Zaměstnanec ÚI musí být o realizaci předmětu smlouvy resp. záměru jeho zapojení do počítačové sítě kupujícího informován prodávajícím s dostatečným předstihem, a to minimálně 10 kalendářních dnů před termínem vlastního plnění v místě plnění (podrobnosti viz níže).

Předmět smlouvy v rámci jeho instalace dle čl. I smlouvy zahrnuje všechny práce související s instalací dodávaných HW/SW částí do plně funkčního stavu. Pokud bude vyžadována prodávajícím součinnost s ÚI, je nutné rozsah této součinnosti předem jasně definovat (ať již jakou součástí smlouvy, projektové dokumentace nebo emailem na adresu vtle@nnm.cz) a to minimálně 1 týden (7 kalendářních dnů) před termínem instalace. Za součinnost se považuje např. i zřízení vzdáleného přístupu přes internet.

Pokud požadavek na součinnost s ÚI svým rozsahem překročí 3 hodiny práce technika ÚI nebo bude vyžadovat plnění třetí strany, vyhrazuje si ÚI právo navrhnout vlastní termíny dle svých kapacitních možností.

Pokud požadavek na součinnost překročí rámec běžných činností zajišťovaných ÚI nebo její rozsah nebude ÚI schopen akceptovat z kapacitních, technických či časových důvodů, může požadovanou součinnost celou nebo její část odmítnout, a to do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku. V tomto případě je prodávající povinen zajistit všechny požadované úkony vlastními technikami nebo externím servisem.

Pokud bude ÚI, ke zdárné realizaci plnění ze smlouvy nucen zajišťovat úkony, které nebyly definovány v požadavcích na součinnost, bude prodávajícímu tato práce účtována ve výši prokazatelných nákladů s nimi spojených a dle platného ceníku kupujícího.



Příloha č. 7 smlouvy

**Pravidla pro zřízení a používání vzdáleného přístupu do
počítačové sítě Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace**

1. *Kupující* umožní vzdálený přístup/připojení do své počítačové sítě nebo její části *prodávajícímu* tak, aby mohl *prodávající* vykonávat veškeré smluvní či objednatelům prokazatelně vyžádané/objednané služby (dále jen „služba“).
2. *Kupující* zřídí vzdálený přístup pro *prodávajícího* na dobu a v rozsahu nezbytně nutnou k plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Technické podmínky vzdáleného připojení jsou dohodnuty takto:
 - a) připojení přes SSH protokol VNC dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - b) připojení přes RDP (Microsoft remote desktop klient) dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - c) VPN přístup dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - d) jiný typ přístupu či autentizace dle individuálně dohodnutých parametrů při podpisu smlouvy.

Předání parametrů přístupu a přístupových hesel zajistí zaměstnanec úseku informatiky a proběhne při podpisu smlouvy.

4. *Prodávající* se zavazuje zajistit, že osoby, jim pověřené k vykonávání služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu, budou dodržovat tyto podmínky:
 - nezneužijí vzdálený přístup do sítě k aktivitám, které nejsou v souladu se smluvním rozsahem poskytovaných služeb, a ani neumožní tyto aktivity třetí osobě.
 - nezneužijí jakoukoliv důvěrnou informaci, s níž přijdou do styku při plnění závazků dle této smlouvy, a ani neposkytnou takovou informaci třetí osobě.
 - zachovají mlčenlivost o skutečnostech a údajích, o nichž se dozví při plnění závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní. To platí zejména o skutečnostech, na něž se vztahuje mlčenlivost zdravotnických a ostatních pracovníků u poskytovatele zdravotních služeb dle § 51 odst. 5 písm. a) až g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



5. *Prodávající* je povinen vždy předem zajistit, že nedojde k nepředpokládanému narušení chodu počítačové sítě (informačního systému), ani jiných služeb a systémů v síti *kupujícího*, jakožto i řádného chodu serverů, počítačů a dalších HW komponent sítě. V případě porušení této povinnosti je *kupující* oprávněn požadovat náhradu způsobené škody.
6. *Prodávající* si vyhrazuje právo službu vzdáleného přístupu dočasně pozastavit či omezit bez udání důvodu. V tomto případě bude o rozhodnutí *kupujícího prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
7. V případě, že *kupující* zjistí použití vzdáleného přístupu v rozporu s těmito pravidly, je *kupující* oprávněn vzdálený přístup *prodávajícímu* zcela zrušit. O tomto rozhodnutí *kupujícího* bude *prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
8. Kontaktní osoby pro účely poskytování služby a předávání informací dle bodů této přílohy

Za kupujícího			
Jméno	Pozice	Telefon	Email
Marek Vala	technik	723190755	it@nnm.cz
Miroslav Bojanovský	technik	603827200	it@nnm.cz
David Lukeš	technik	723190755	it@nnm.cz

Za prodávajícího			
Jméno	Pozice	Telefon	Email
Miroslav Šoulák	jednatel	602759167	msoulak@ztechnik.cz
Daniela Staňková	manažer přip. zak.	725265416	dstankova@ztechnik.cz
.....			