


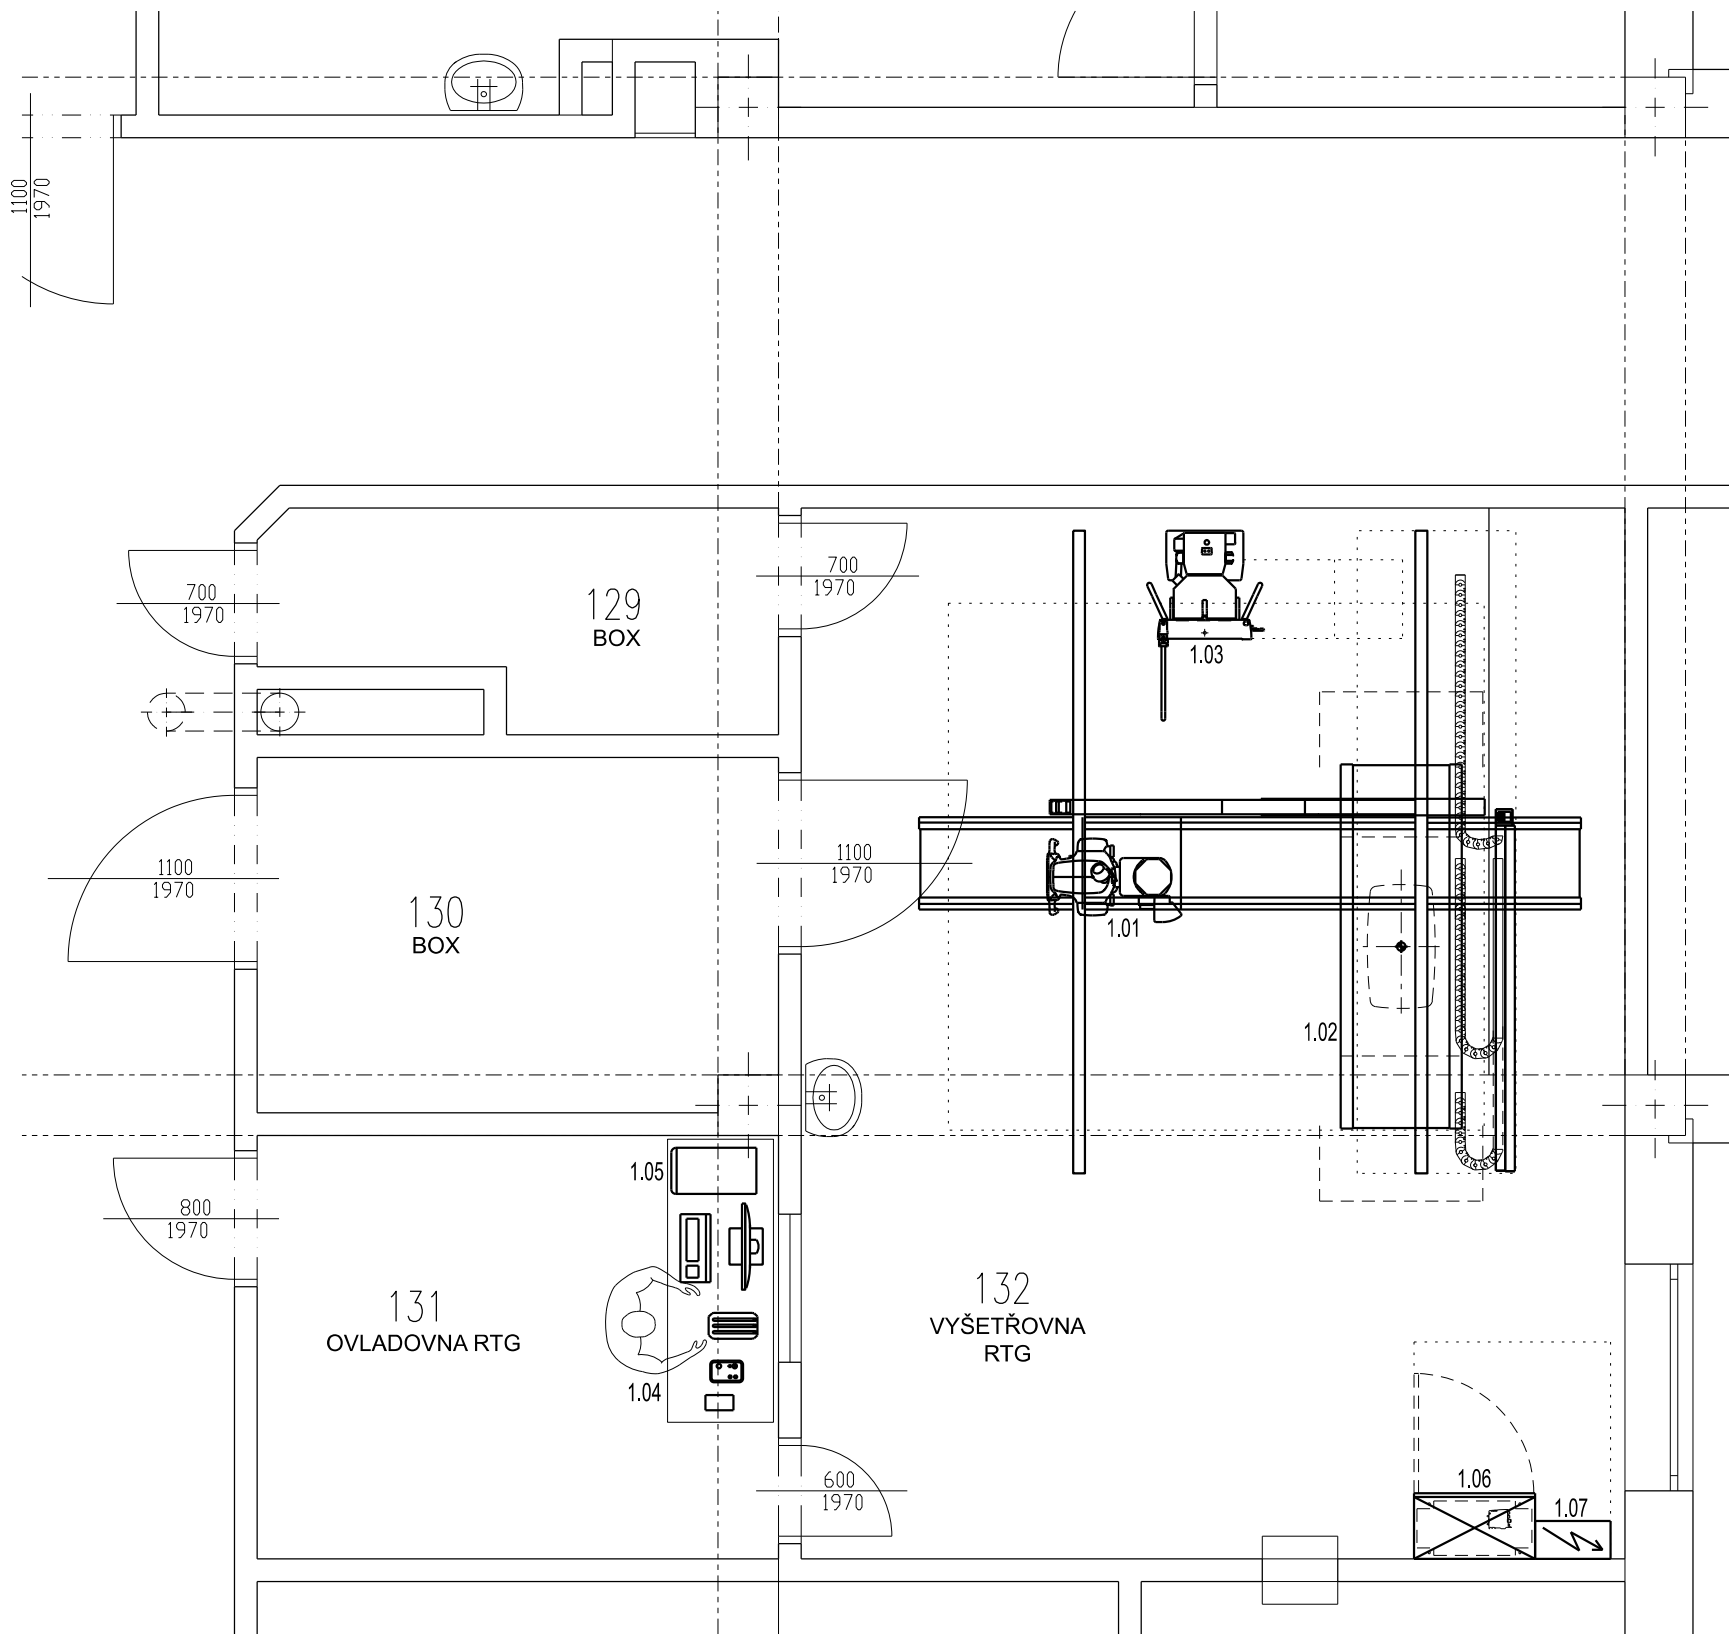

Přesné uspořádání technologie skiagrafického kompletu Ysio X.pree firmy Siemens bude konzultováno s uživatelem po ukončeném výběrovém řízení.

LEGENDA ZAKRESLENÉHO ZAŘÍZENÍ FIRMY SIEMENS:

- 1.01 Systém Ysio X.pree - stropní stativ s rtg lampou, hmotnost cca 437 kg
- 1.02 Systém Ysio X.pree - patientský stůl, hmotnost cca 440 kg
- 1.03 Systém Ysio X.pree - vertikální stativ, hmotnost cca 287 kg
- 1.04 Systém Ysio X.pree - obrazový systém, hmotnost cca 24 kg
- 1.05 Systém Ysio X.pree - ovládací prvky včetně monitoru
- 1.06 Systém Ysio X.pree - generátor 80 kW, hmotnost cca 428 kg
- 1.07 Systém Ysio X.pree - technologický rozvaděč

Nouzová tlačítka AT a EAT.
Přesná specifikace dodávaných komponent - viz nabídka.

Požadované prostředí na pracovišti RTG:

Vyšetřovna RTG - teplota s ohledem na technologii 18°C až 28°C
- relativní vlhkost 20% až 75 % v celém ročním období
- vyzářené teplo max. 2,5 kW

Ovladovna - teplota s ohledem na technologii 18°C až 28°C
- relativní vlhkost 20% až 75 % v celém ročním období
- vyzářené teplo max. 0,5 kW

Silnoproudý přívod pro technologii RTG kompletu Ysio X.pree firmy Siemens:

Hlavní přívod proudu pro skiagrafický RTG komplet Ysio X.pree firmy Siemens 5-ti vodičový Cu vodiče dimenzované dle těchto udaných hodnot: 3 ~ 400 V (+/- 10%) + N + PE, 50 Hz), připojovací příkon 35 kVA, nárazový špičkový příkon 126 kVA s požadavkem na vnitřní odpor sítě max. 0,11 Ω až do místa napojení. Jištění v technolog. rozvaděči 63 A. Pro skiagrafický RTG komplet uvažovat samostatný přívod.

Transport:

Požadovaný transportní průchod po celé trase transportu o šířce min. 1050 mm (při standardní výšce dveří 1 970 mm). Hmotnost transportu 471 kg.

VÉREJNÁ ZAKÁZKA

Nemocnice Havlíčkův Brod
RTG skiagrafický přístroj

PŘÍSTROJ

Ysio X.pree firmy Siemens

DATUM

LEDEN 2022

MĚŘÍTKO

1 : 50