

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Stolní elektronový mikroskop
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-049754
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P22V00000904
Datum zahájení zadávacího řízení:	5. 12. 2022
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
IČO:	00090735
Adresa sídla:	Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zastupující zadavatele v zadávacím řízení Ing. Marek Bena e-mail: benam@pkkv.cz tel.: 604 119 057

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 7. 12. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 13.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:


Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat skenovací elektronový mikroskop, který se neumisťuje na běžný laboratorní stůl s nosností do 100 kg, protože má vlastní sestavu i se stolem o hmotnosti celého systému 510 kg, což je standardní váha plně vybaveného elektronového mikroskopu.

Naše řešení odpovídá elektronovému mikroskopu s elektronovým optickým zvětšením až do 1 000 000 s kvalitou obrazu 32 000 x 24 000 pixelů, takže zadavatel získá kvalitnější obraz a tím získá více informací o zkoumaném vzorku.

Bude zadavatel akceptovat elektronový mikroskop o těchto rozměrech?

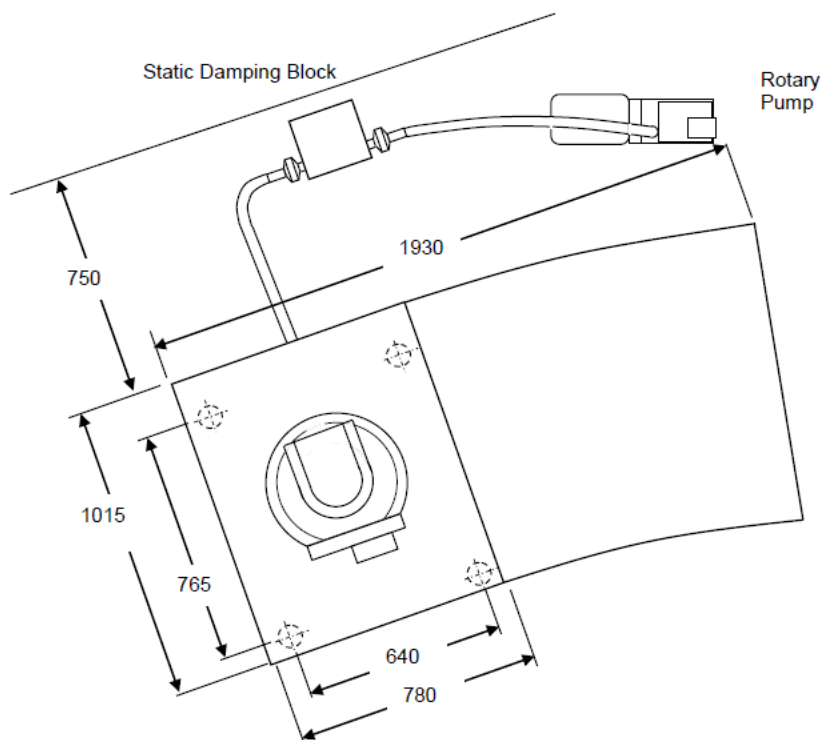

Odpověď zadavatele:

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že poptává druh přístroje s některými parametry, které jiné přístroje dostupné na trhu, které lze označit jako „velké“ elektronové mikroskopy, výkonově mohou předčit. Nicméně z provozních důvodů (potřeba opakovaného snazšího přemístění přístroje v nejbližších letech) je zadavatel nucen trvat na dodávce přístroje „kompaktního“, tj. stolního elektronového mikroskopu tak, jak je stanoveno v zadávací dokumentaci.

V Jihlavě

.....
RNDr. Karel Malý, Ph.D.

ředitel

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky