


1:20

Podhled

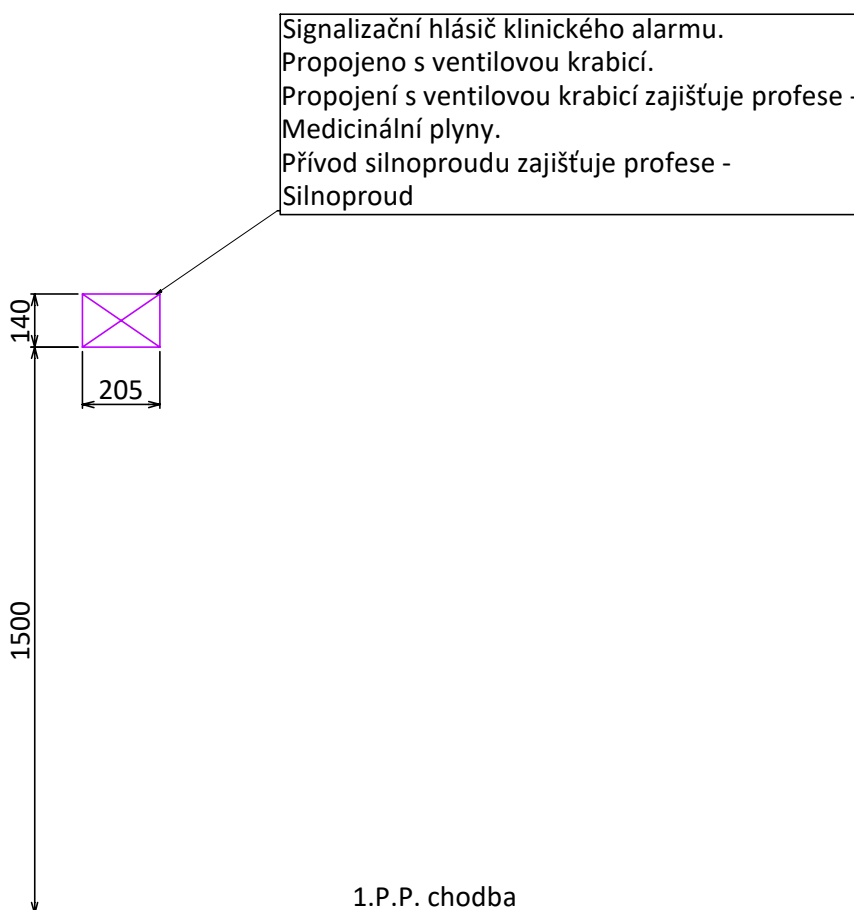

Signalizační panel klinického alarmu dle ČSN EN ISO 7396-1

[illegible]