



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Bronchoskopická sestava
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/19/32

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 24.9.2019 „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“. Úplné znění žádosti i vyjádření zadavatele jsou uvedeny níže.

Znění žádosti:
Dotaz č. 1 Zadavatel v zadávací dokumentaci u položky č.6., část 6.1. Videobronchoskop terapeutický požaduje zevní průměr tubusu max. 6,0 mm. Uchazečem nabízený videobronchoskop má zevní průměr tubusu 6,4 mm, jde tedy o méně než 10% rozdíl oproti požadovanému průměru tubusu. Akceptuje zadavatel nabídku přístroje, jehož zevní průměr tubusu je 6,4 mm za předpokladu splnění všech dalších měrných jednotek?
Vyjádření zadavatele
Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje, jehož zevní průměr tubusu bude větší, než 6,0 mm. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný požadavek ve vztahu k ostatním nepodkročitelným technickým požadavkům zadavatele.

Znění žádosti:
Dotaz č. 2 Zadavatel v zadávací dokumentaci u položky 6., část 6.1. Videobronchoskop terapeutický požaduje systém rotace zaváděcího tubusu min.120° vpravo/vlevo. Rotace tubusu je technické řešení konkrétního výrobce, neslouží k žádnému medicínskému účelu, pouze pro snadnější manipulaci při výkonu. Ze stejného důvodu, tj. pro snadnou manipulaci při výkonu, nabízí uchazeč videobronchoskop s otočným konektorem o 180°. Akceptuje zadavatel technické řešení jiného výrobce, otočný konektor o 180 °, který slouží ke stejnému účelu?

Vyjádření zadavatele

Zadavatel nebude akceptovat technické řešení - otočný konektor o 180 ° a i nadále trvá na stanoveném - objektivně zdůvodnitelném požadavku.

Požadovaná rotace zaváděcího tubusu umožňuje snadnější a ergonomickou manipulaci při výkonu a zajištění lepšího přístupu k portu pracovního kanálu. Tento je pak možné za použití rotace vrátit zpět do kolmé polohy k vodorovné ploše při zavedení do periferií bronchiálního stromu. Tím je snížen stres pro zápěstí a zajištěna pohodlnější poloha pro bronchoskopistu, lepší ergonomie přístupu pro sestru při výkonu, a také lepší viditelnost. Optika může být posunuta pryč od průduškové stěny, a tak zůstává čistá i v obtížných pasážích průdušek. Vámi uváděný otočný konektor slouží k připojení světlovodného tubusu endoskopu (nikoliv zaváděcího tubusu) k endoskopické věži a rotace konektoru teoreticky snižuje možnost poškození světlovodného tubusu. Tyto dva pojmy, rotace zaváděcího tubusu a rotační konektor tak zcela jistě neplní technicky ani medicínsky stejný účel.

Znění žádosti:

Dotaz č. 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci u položky 6. část 6.2. Videoprocessor s klávesnicí, pořadové číslo 13., požaduje nastavení velikosti zobrazení ve velikostech: Medium, Semi-full a Full screen.

Uchazeč se domnívá, že požadovaná velikost Semi-full nemá žádné medicínské opodstatnění a nepřináší žádné výhody pro uživatele oproti videoprocessoru, který umožňuje přepnutí mezi zobrazením Full a Medium.

Umožní zadavatel dodání videoprocessoru, který přepíná velikost zobrazení endoskopických snímků mezi možnostmi Full a Medium?

Vyjádření zadavatele

Zadavatel umožní dodání videoprocessoru, tak, jak je uvedeno výše, tj. který přepíná velikost zobrazení endoskopických snímků mezi možnostmi Full a Medium.

Znění žádosti:

Dotaz č. 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci u položky 6. část 6.2. Videoprocessor s klávesnicí, pořadové číslo 24. požaduje možnost zobrazení až 4 vybraných snímků v indexu na monitoru.

Námi nabízený videoprocessor nedisponuje funkcí, která by umožňovala zobrazení 4 vybraných snímků v indexu na monitoru, ale záznamové zařízení, které je součástí nabízeného videořetězce tuto funkci umožňuje.

Akceptuje zadavatel skutečnost, že bude dodán videosystém, kde funkci zobrazení až 4 vybraných snímků v indexu na monitoru umožňuje záznamové zařízení?

Vyjádření zadavatele

Zadavatel nebude akceptovat nabídku videosystému, kde funkci zobrazení až 4 vybraných snímků v indexu na monitoru umožňuje záznamové zařízení. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný požadavek - požadovaná indexace slouží k zobrazení předchozího snímku, nálezů a porovnání s live obrazem během vyšetření.

Znění žádosti:

Dotaz č. 5

Zadavatel v zadávací dokumentaci u položky 6. část 6.2. Videoprocessor s klávesnicí, pořadové číslo 27. požaduje archivace obrázků na Flash Disc ve formátech TIFF, JPEG.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel požaduje archivaci obrázků ve formátu kompresním - JPEG a formátu bez komprese - TIFF. Archivovat obrázky bez komprese umožňuje stejně jako formát TIFF i formát BMP.

Bude zadavatel akceptovat takový videoprocessor, který umožňuje archivaci obrázků na Flash Disc ve formátu JPEG-kompresním a formátu BMP-bez komprese?

Vyjádření zadavatele

Zadavatel nebude akceptovat nabídku videoprocessoru, který umožňuje archivaci obrázků na Flash Disc ve formátu JPEG-kompresním a formátu BMP-bez komprese. Zadavatel trvá na formátu TIFF - jedná se o bezeztrátový komprimovaný formát ukládání dat, BMP formát je formátem nekomprimovaným, tedy pro ukládání dat používá a vyžaduje velký datový prostor.

Znění žádosti:

Dotaz č. 6

Zadavatel v zadávací dokumentaci u položky 6.část 6.3. Zdroj studeného světla, pořadové číslo 36. požaduje hlavní vyšetřovací lampu 300W.xenon

V současné době se často používá energeticky úspornější LED zdroj světla, který splňuje veškeré požadavky nutné pro výkony. Námi nabízený procesor má hlavní vyšetřovací lampu 150W xenon, která má větší svítivost než běžně používané LED zdroje.

Zadavatel požadavkem na 300W xenon neumožňuje uchazeči nabídnout modernější endoskopický systém s energeticky úspornějším zdrojem světla na bázi výbojky 150 W s menšími rozměry a nižší hmotností, který však s velkou rezervou pokrývá potřebu na dostatečnou intenzitu osvětlení.

Umožní zadavatel uchazeči dodání videoprocessoru s hlavní vyšetřovací lampou 150W xenon?

Vyjádření zadavatele

Zadavatel neumožní nabídnout videoprocessor s hlavní vyšetřovací lampou 150W xenon a nadále trvá na svém objektivně zdůvodnitelném požadavku xenonového zdroje světla o výkonu 300W.


Tazatel ve svém dotazu sám argumentuje srovnáním s LED světelnými zdroji a uvádí větší svítivost u 150W xenonového zdroje než je u LED - z této argumentace logicky vyplývá, že 300W xenon má nejvyšší svítivost a zcela jistě vyšší než 150W xenonový zdroj. Světelný zdroj o požadovaném výkonu mohou nabídnout všichni přední výrobci, včetně tazatele.

Uveřejnění a poskytnutí Vysvětlení zadávacích podmínek

Pro vysvětlení zadávacích podmínek je v souladu s článkem 13.2 Výzvy k podání nabídky ze dne 16.9.2019 (dále jen „výzva“) využito elektronických prostředků, tj. toto Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti bude odesláno všem zadavateli známým dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK.

Současně je Vysvětlení zadávacích podmínek uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

V Novém Městě na Moravě dne 25.9.2019

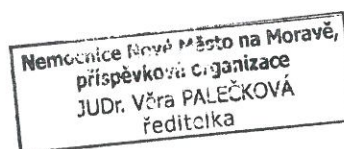

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice