


Půdorys místa plnění (vyšetřoven)

Přístroj nahrazující stávající zařízení (Hercules 65-S, výrobce Canon) na radiodiagnostickém oddělení v hlavní lůžkové budově



Přístroj nahrazující dosluhující přístroj (Ysio wi-D, výrobce Siemens) v pavilonu akutní medicíny

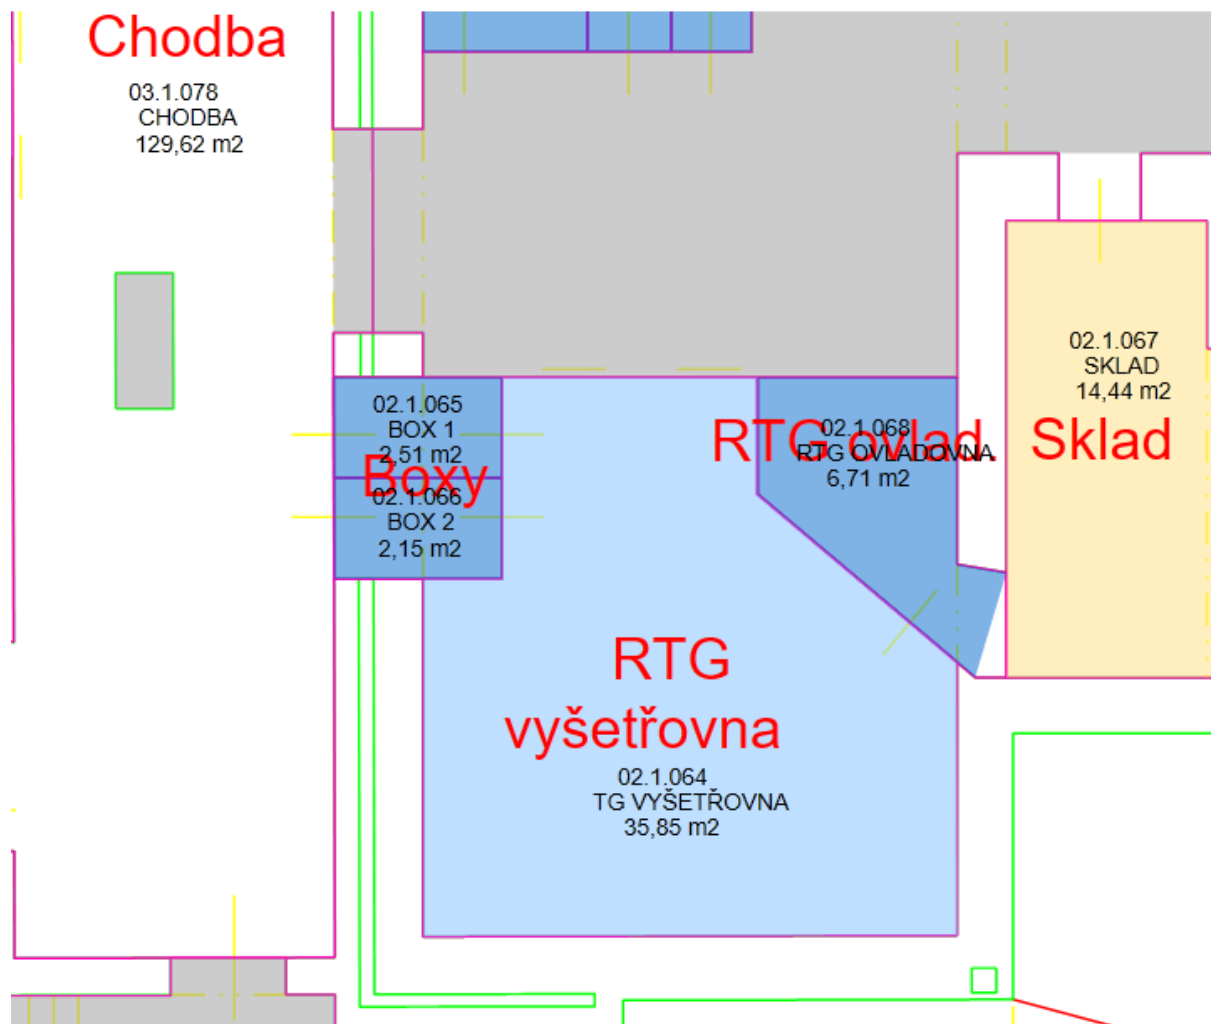