

KUPNÍ SMLOUVA č. VZ2.1 část 3

kterou podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku

Smluvní strany:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7759270227/0100 (pro investiční dodávky)

12338711/0100 (pro neinvestiční dodávky)

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

CHEIRÓN a.s.

sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov

IČO: 27094987

DIČ: CZ27094987

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Městským soudem v Praze pod značkou B 8964

zastoupená Ing. Jindřichem Petříkem, MBA, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279233863/0300

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

takto:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o VZ**“). Kupující je podle zákona o VZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.
- 1.2. Kupující dále prohlašuje, že oznámil zahájení zadávacího řízení v informačním systému způsobem podle § 212 zákona o VZ otevřené řízení ve smyslu § 56 zákona o VZ za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „**Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 1**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku otevřeného řízení byla Veřejná zakázka přidělena Prodávajícímu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky.
- 1.3. Předmět plnění Veřejné zakázky je spolufinancován v rámci poskytnuté dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program) a podléhá proto i jeho obecným pravidlům pro žadatele a příjemce.

2. Smluvní strany

- 2.1. Kupující prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřizovatele Kraje Vysočina, která se zabývá poskytováním komplexních zdravotnických služeb. Kupující dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.2. Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), která se zabývá prodejem, dodávkou, instalací a montáží zdravotnických přístrojů, jakož i dalšího plnění sjednaného v této smlouvě. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, jakož i podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich činností.

3. Předmět a účel smlouvy

- 3.1. Účelem této smlouvy je pořízení zdravotnických technologií a vybavení v níže uvedené specifikaci pro provoz ve zdravotnickém zařízení.
- 3.2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu nové, dosud nepoužité zdravotnické technologie a vybavení (dále jen „zařízení“), dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení. Součástí dodávky zařízení jsou následující věci, doklady a činnosti nezbytné k řádnému užívání zařízení:
 - doprava zařízení na místo plnění včetně zajištění transportní cesty a zabezpečení všech stavebních konstrukcí proti poškození,
 - uvedení do provozu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy výrobce, včetně zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu trvání záruční doby
 - provedení instruktáže (zaškolení) osob kupujícího v rozsahu dle jeho požadavků, dle požadavků výrobce zařízení a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, to vše v českém jazyce v sídle kupujícího, je-li tento požadavek pro konkrétní zařízení vyžadován výrobcem
 - dodací list včetně výrobních čísel zařízení, pokud tyto zařízení mají výrobní čísla
 - dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to jak v tištěné tak i elektronické podobě,
 - dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky (zařízení) k účelu užívání v České republice, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží prodávající současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU, včetně dodání dokladů, které osvědčují splnění požadavků kladených na zařízení, jenž vyplývají ze zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a z prováděcích předpisů.

Touto smlouvou se prodávající dále zavazuje k:

- provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTk), v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a v souladu s doporučením výrobce včetně předávání protokolů z nich Kupujícímu ve lhůtě do 2 týdnů od jejich dokončení a to po celou dobu záruční lhůty,
- provádění odborné údržby (preventivní údržby a oprav) v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce včetně provádění oprav a to po celou dobu záruční lhůty,
- hlídání a dodržování zákonem a výrobcem stanovených termínů PBTk a odborné údržby a to po celou dobu záruční lhůty,

s tím, že pokud konkrétní Zařízení dle právních předpisů či doporučení výrobce provádění uvedených činností (nad rámec plnění povinností ze záruky či z odpovědnosti za vady) nevyžadují, tak se tyto další závazky prodávajícího vůči nim neuplatňují.

Uvedené činnosti rovněž tvoří resp. se považují za součást plnění dle této smlouvy v době sjednané záruční lhůty a prodávající nemá za jejich provádění nárok na jakékoli zvláštní finanční či obdobné kompenzace.

- 3.3. Technická specifikace dodaných zařízení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
- 3.4. Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího řádně a včas uskutečňenou dodávku převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je komplex pavilonu chirurgických oborů (budova PCHO, G a O), (dále též jen „**místo plnění**“) Kupujícího na adrese: **Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč**. V okamžiku uzavření této kupní smlouvy se budova PCHO nachází ve stavu rozestavěnosti a budovy G a O před plánovanou rekonstrukcí, což reflektují a zohledňují níže uvedená ujednání smluvních stran. Bude-li místem plnění pouze některá z budov, vyplýne to z Přílohy č. 3 – Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny.

5. Doba plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Zařízení v místě plnění, zajistit jeho uvedení do provozu a provést instruktáž (zaškolení) obsluhy a uvést Zařízení do provozu, to vše nejpozději do **šedesáti (60) dnů** od obdržení písemného sdělení Kupujícího, že je připraven Zařízení převzít. Kupující předmětné sdělení odešle prodávajícímu způsobem uvedeným v čl. 16.1. této smlouvy nejdříve v okamžiku, kdy bude možné s ohledem na stupeň rozestavěnosti budovy PCHO a rekonstrukce budov O a G ve sjednané lhůtě 60 dnů provést instalaci a montáž Zařízení včetně provedení souvisejících činností. Dodání proběhne ve dvou termínech a to zdravotnické technologie a vybavení do budovy PCHO, kdy dle aktuálních předpokladů a předpokládaného termínu dokončení stavby budovy PCHO lze očekávat odeslání výzvy v průběhu třetího čtvrtletí 2017, a zdravotnické technologie a vybavení do budov O a G, kdy dle aktuálních předpokladů a předpokládaného termínu dokončení rekonstrukce budov O a G lze očekávat odeslání výzvy v průběhu prvního čtvrtletí 2018.

6. Kupní cena

- 6.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy.

- 6.2. Kupní cena činí celkem za dodávku Zařízení 1 290 169,00 Kč (slovy jedenmiliondvěstědevadesát tisícstošedesátdevět korun českých) bez daně z přidané hodnoty, tj. 1 561 104,49 Kč (slovy jedenmilionpětsetšedesátjednatřicistochtyři korun českých a čtyřicetdevět haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.

Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek a součástí Zařízení v Příloze č. 3 této smlouvy.

- 6.3. Kupující zaplatí kupní cenu sjednanou v odst. 6.2. této smlouvy takto:

6.3.1. Část kupní ceny za dodávku zařízení do budovy PCHO (I. etapa) bude Kupujícím zaplacená po převzetí a předání Zařízení určeného pro budovu PCHO na základě potvrzených předávacích protokolů, tzn. po dodání Zařízení včetně všech součástí a příslušenství, provedení montáže a instalace Zařízení v místě plnění, jeho uvedení do provozu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., to vše v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy.

6.3.2. Zbývající část kupní ceny z celkové ceny za dodávku zařízení do budov O a G (II. etapa) bude Kupujícím zaplacená po převzetí a předání Zařízení určeného pro budovy O a G na základě potvrzených předávacích protokolů, tzn. po dodání Zařízení včetně všech součástí a příslušenství, provedení montáže a instalace Zařízení v místě plnění, jeho uvedení do provozu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., to vše v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy.

6.3.3. Faktura na každou část kupní ceny bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Prodávající je povinen zaslat fakturu Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 6.6. této smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Faktura bude vystavena nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne splnění podmínek dle čl. 6.3.1. resp. 6.3.2. této smlouvy. Prodávající nemá právo požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. Faktury budou vystaveny samostatně pro investiční a neinvestiční dodávky (určí kupující).

6.3.4. Bude-li místem plnění pouze některá z budov (etapa I. nebo etapa II.), jak vyplývá z Přílohy č. 3 – Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny, dojde k vystavení pouze jedné faktury a to buď dle čl. 6.3.1., nebo dle čl. 6.3.2.

- 6.4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě faktur(y) vystavených v souladu s odst. 6.3.1. a 6.3.2. této smlouvy a ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 6.3.3. této smlouvy. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

- 6.5. Prodávající se zavazuje uvést na vystavených fakturách číslo této smlouvy a číslo projektu (identifikační číslo EIS projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356, identifikační číslo: 117D03F000033).

- 6.6. Faktura(y) musí být vystavena(y) a zaslána(y) ve formě stanovené v předchozím odstavci této smlouvy a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a rovněž údaje stanovené v odst. 6.7. této smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude oboustranně podepsaný dodací list.

- 6.7. Faktura(y) Prodávajícího musí dále obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a adresy jejich sídla, IČ a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto smlouvou, název Veřejné zakázky, fakturovanou částku, event. razítko, podpis oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

- 6.8. Nebude-li faktura(y) vystavena(y) a zaslána(y) ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě osmi (8) dnů od jejího obdržení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

- 6.9. Kupní cena uvedená v odst. 6.2. této smlouvy představuje cenu konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou, zejména případné daně (zejména daň z přidané hodnoty), poplatky, cla a jiné podobné platby včetně nákladů na balení, dopravu Předmětu smlouvy do místa plnění, montáž, instalaci a pojištění a další související náklady (zejm. na činnosti uvedené v čl. 3.2.), jak vyplývá z této smlouvy. Veškeré náklady spojené

s dodávkou, montáží, instalací a uvedením Předmětu smlouvy do běžného provozu nese výlučně Prodávající, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

- 6.10. Kupní cena (nebo její část) se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího (resp. z účtu, ze kterého bude poukazována) ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 6.11. Kupující není v prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po kterou je Prodávající v prodlení se splněním některé ze svých povinností dle tohoto článku smlouvy.
- 6.12. Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce Prodávajícího podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odepřít plnění z této smlouvy v případě, že závazek Prodávajícího z této a/nebo jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.

7. Povinnosti Prodávajícího

- 7.1. Prodávající se při plnění Předmětu smlouvy a jeho uvádění do provozu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy, jakož i pravidla Kupujícího platná pro provoz v areálu Nemocnice Třebíč, se kterými bude Prodávající seznámen.
- 7.2. Prodávající je povinen počínat si při plnění smlouvy tak, aby provoz Kupujícího (zejména provoz v místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře. Prodávající je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejmenší.
- 7.3. Prodávající je povinen do data předání a převzetí Předmětu smlouvy dle čl. 9. této smlouvy uskutečnit instruktáž (školení) obsluhy ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb. a jeho prováděcích předpisů, včetně vystavení protokolu o této instruktáži pověřeným pracovníkům Kupujícího v místě plnění a v potřebném rozsahu a předvést ukázkou funkcí Předmětu smlouvy tak, aby ti mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat. Školení musí být provedeno v českém jazyce. Po ukončení školení vystaví Prodávající písemný protokol o zaškolení všech zaškolených osob, který bude dokladem o jejich způsobilosti řádně, rutinně a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat Předmět smlouvy. Prodávající je rovněž povinen na základě případného požadavku Kupujícího i během záruční doby proškolit jeho pověřené pracovníky v místě plnění a v potřebném rozsahu a předvést ukázkou funkcí Předmětu smlouvy tak, aby ti mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat. Na toto školení se použijí též ostatní podmínky uvedené v tomto odstavci smlouvy. Tyto povinnosti se netýkají zařízení, u kterých to nevyžadují platné právní předpisy, zejména zákon č. 268/2014 Sb. Prodávající je dále povinen předat Kupujícímu nezbytnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.
- 7.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy a bude plně způsobilý plnit svoji funkci v rozsahu a za účelem vyplývajícím z této smlouvy a Zadávací dokumentace, jinak v rozsahu obvyklém pro Předmět smlouvy daného druhu a způsobu využití. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude plně použitelný k účelu, pro který si Kupující tento Předmět smlouvy objednal.
- 7.5. Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a s odbornou péčí a předcházet hrozcím škodám. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zařízení nové, nepoužité. Prodávající je povinen zajistit a odpovídá Kupujícímu za to, že jím dodávaný Předmět smlouvy (resp. jeho jednotlivé části, na které se tento požadavek dle legislativy vztahuje) bude v potřebném rozsahu splňovat požadavky vyplývající z příslušných předpisů a norem Evropské unie a České republiky.
- 7.6. Prodávající je povinen opatřit veškeré věci potřebné ke splnění této smlouvy, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
- 7.7. Prodávající je povinen včas doložit všechna povolení, souhlasy, schválení zkoušky, atesty a ostatní náležitosti potřebné a/nebo obvyklé pro uvedení Předmětu smlouvy do řádného provozu a pro jeho následné používání Kupujícím tak, aby používání Předmětu smlouvy při provozu nebylo ničím a nijak omezeno (viz též čl. 5.1.).

- 7.8. Prodávající musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní činností a pro případ škody způsobené vadou dodaného Předmětu smlouvy až do doby uplynutí sjednané záruční doby dle čl. 11. Kopii pojistného dokladu je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.
- 7.9. Prodávající odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se jednalo o jeho vlastní plnění.
- 7.10. Prodávající se zavazuje dodat Předmět smlouvy v takovém provedení a s takovými vlastnostmi faktickými i právními, které umožní řádné provádění pozáručního servisu, včetně všech servisních, revizních a jiných výrobcem a/nebo obecně závaznými nebo jinými předpisy předepsaných prohlídek a kontrol, kteroukoliv osobou mající obecně odbornou způsobilost pro provádění servisu technických zařízení daného druhu.
- 7.11. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 7.12. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě porušení těchto povinností odpovídá Prodávající za způsobenou škodu.

8. Práva a povinnosti Kupujícího

- 8.1. Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu dodávku, montáž, instalaci a uvedení Předmětu smlouvy do provozu v místě sjednaného.
- 8.2. Kupující se zavazuje na svůj náklad provést technickou připravenost na umístění, montáž a instalaci Předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu, aby mohl Prodávající řádně plnit závazky z této smlouvy. Tento závazek Kupujícího zahrnuje pouze zajištění přívodů a odvodu na určená místa, nikoliv napojení Předmětu smlouvy na tyto přívody a odvody, které svým nákladem zajišťuje Prodávající. Tato povinnost se týká zařízení, u kterých to bude vyžadovat v potřebném rozsahu kupující na základě objektivních podmínek v místě plnění.
- 8.3. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu i další součinnost v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Případné konkrétní požadavky k součinnosti je však Prodávající povinen Kupujícímu sdělovat některým ze způsobů uvedených v čl. 16. a to bez zbytečného odkladu. Uvedené požadavky přitom mohou být pouze provozního charakteru a po Kupujícím rozumně požadovatelné, přičemž v žádném případě nesmějí vyvolat žádné dodatečné náklady na straně Kupujícího.
- 8.4. Kupující je povinen převzít řádně dodaný Předmět smlouvy v místě určeném touto smlouvou (místo plnění) a v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 8.5. Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu a jeho pracovníkům a dalším osobám oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup do místa plnění. Prodávající je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a zajištění bezpečnosti v místě plnění.
- 8.6. Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a kontrolovaly, zda Prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy Prodávajícím.
- 8.7. V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je Kupující oprávněn udělovat Prodávajícímu pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Prodávající je povinen takové pokyny respektovat.
- 8.8. Kupující není povinen od Prodávajícího odebírat jakýkoliv spotřební materiál určený pro užívání Předmětu smlouvy (Zařízení), zejména pokud jde o spotřební materiál určený k jeho provozu.

9. Převzetí Předmětu smlouvy

- 9.1. Kupující je povinen Předmět smlouvy převzít, jakmile bude dodávka ve smyslu čl. 3.2. Smlouvy splněna ve všech částech a Prodávající jej k převzetí vyzve. Předání a převzetí Předmětu smlouvy přitom proběhne ve dvou etapách (částech) na základě dvou výzev Prodávající, a to zvlášť pro Zařízení určené pro budovu PCHO a zvlášť pro Zařízení určené pro budovy O a G. Bude-li místem plnění pouze některá z budov, proběhne předání a převzetí pouze v jedné etapě.
- 9.2. Předpokladem předání a převzetí Předmětu smlouvy je prokázání, že Předmět plnění je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace (viz Příloha č. 1 této smlouvy). Během předávání a převzetí Předmětu smlouvy Prodávající předvede v místě plnění Kupujícímu, že Předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto smlouvou. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu pracovní den, kdy má dojít k předání a převzetí Předmětu smlouvy v místě plnění s dostatečným předstihem, nejméně však tři (3) pracovní dny předem.
- 9.3. Smluvní strany sepiší o předání a převzetí Předmětu smlouvy předávací protokol.
- 9.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu smlouvy od Prodávajícího zejména v případě, že Předmět smlouvy bude vykazovat jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící provozu.
- 9.5. Bude-li k uvedení Předmětu smlouvy do provozu zapotřebí obstarat souhlas orgánů veřejné moci či splnění jiné obdobné podmínky, zavazuje se Prodávající dodat včas podklady pro takový souhlas, aby mohly být řádně splněny termíny uvedené v článku 5. této smlouvy.

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- 10.1. Vlastnictví k Zařízení a všem jeho součástem a příslušenství přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 10.2. Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

11. Záruka a práva z vadného plnění

- 11.1. Prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím přijímá závazek s tím, že poskytuje na Zařízení včetně všech jeho součástí a příslušenství, jenž tvoří předmět této smlouvy, záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí dle článku 9. této smlouvy i po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilý pro užívání ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního servisu jsou blíže upraveny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.2. Záruční doba stanovená v Příloze č. 2 této smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy. V případě, že k předání a převzetí Předmětu smlouvy dojde ve dvou etapách (částech), začíná i záruční doba běžet samostatně pro každou z nich, tedy zvlášť pro Zařízení určené do budovy PCHO a zvlášť pro Zařízení určené do budov O a G.
- 11.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude dodán v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.
- 11.4. Prodávající rovněž odpovídá za faktické i právní vady zařízení dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. Dodání vadného plnění se přitom vždy považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující má v případě vzniku práv z vadného plnění nároky uvedené v právních předpisech a to zejména v občanském zákoníku.
- 11.5. Volba mezi nároky (z titulu odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění) náleží vždy Kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).
- 11.6. Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Kupujícím, pokud je Kupující oznámí Prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se považuje za řádně

učiněné také v případě, jestliže je Kupující zašle Prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Prodávajícím.

- 11.7. V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

12. Práva k duševnímu vlastnictví

- 12.1. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Zařízení, které je předmětem této kupní smlouvy, včetně řídicího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy Zařízení (dále též jen „**řídicí programové vybavení**“) zůstávají majetkem Prodávajícího. Prodávající tímto (jako nedílnou součást předmětu plnění dle této smlouvy) uděluje Kupujícímu neexkluzivní a časově neomezenou licenci k použití řídicího programového vybavení výhradně k provozu Zařízení pro jeho vlastní účely s tím, že tato licence zůstává spojena se Zařízením i v případě, že s tímto bude v budoucnu Kupujícím právně nakládáno (viz též čl. 12.2.). Pro případ existence práv třetích osob k duševnímu vlastnictví vztahujících se k Zařízení Prodávající prohlašuje, že má za tímto účelem oprávnění k poskytování neexkluzivních a časově neomezených sublicencí, která tvoří součást licence poskytnuté v předchozí větě.
- 12.2. Kupující nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídicím programovým vybavením kromě jeho užívání, zpracování a změn souvisejících s běžným užíváním a provozem daného Zařízení, včetně případného propojení s dalším provozním vybavením Kupujícího. Licence stejného rozsahu přechází na případného nového vlastníka Zařízení. Kupující či jeho nástupce je oprávněn poskytnout svá práva vyplývající z udělené licence podle této smlouvy další osobě, která bude pro Kupujícího provádět údržbu a opravy Zařízení a zajišťovat běžný provoz tohoto Zařízení.
- 12.3. Pokud se na konkrétní Zařízení nevztahují práva k duševnímu vlastnictví, ujednání dle čl. 12. této smlouvy se na něho nevztahují.

13. Sankce

- 13.1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení se splněním závazného termínu stanoveného v odst. 5.1. této smlouvy.
- 13.2. Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.11. této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy.
- 13.3. Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.
- 13.4. Přesáhne-li výše škody, způsobené Kupujícímu porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, smluvní pokutu, zavazuje se Prodávající nahradit Kupujícímu způsobenou škodu přesahující smluvní pokutu.
- 13.5. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Prodávající poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Bez ohledu na ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Kupující požádá Prodávajícího o zaplacení smluvní pokuty.
- 13.6. Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.
- 13.7. Za porušení právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže se některé prohlášení Prodávajícího, učiněné v této smlouvě nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, ukáže být nepravdivým, nepřesným či zavádějícím (dále též jen „**Porušení prohlášení**“). Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu škodu, a to včetně nemajetkové újmy, která mu vznikne v příčinné souvislosti s Porušením prohlášení, neboť Porušení prohlášení se považuje za porušení povinnosti Prodávajícího jednat poctivě, čestně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dále za porušení povinnosti Prodávajícího předcházet hrozícím škodám.

14. Ochrana informací

- 14.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost a zachovávat výrobní či obchodní tajemství druhé smluvní strany, a to ohledně všech skutečností, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které takto případně budou dotčenou smluvní stranou výslovně označeny, nepůjde-li o skutečnosti obecně známé.
- 14.2. Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.
- 14.3. Omezení stanovená v odst. 14.1. této smlouvy se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Omezení stanovená v odst. 14.1. této smlouvy se dále nevztahují na zveřejnění informací a celého textu smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění informací a smlouvy na profilu zadavatele veřejné zakázky, ani na poskytnutí informací včetně celého textu smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Smluvní strany k tomu shodně prohlašují, že text této uzavřené kupní smlouvy neobsahuje žádné skutečnosti ve smyslu čl. 14.1.
- 14.4. Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 14.5. Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplyvá jinak.
- 14.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.
- 14.7. Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje po ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových médiích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat.
- 14.8. Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Prodávající dostane do styku při plnění této smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Kupujícího.

15. Právní nástupnictví

- 15.1. Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit a/nebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po částech. K tomu dává Prodávající Kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.
- 15.2. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

16. Komunikace smluvních stran a pověřené osoby

- 16.1. Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu pro doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastížen (listina bude vrácena poštou s označením, že druhá smluvní strana nebyla zastížena), stává se doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen druhé smluvní straně.
- 16.2. Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv zejména písemnosti, jejichž předmětem je návrh či akceptace změny smlouvy, výtka porušení smluvní povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od smlouvy), jakož i nároky Kupujícího dle čl. 11. této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené druhou smluvní stranou, prostřednictvím datových schránek, popř. jiným způsobem smluvními stranami v průběhu trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly na vytvoření pracovního týmu, který bude vzájemně úzce spolupracovat při plnění technických, provozních či organizačních úkolů dle této smlouvy a účastnit se případných koordinačních schůzek. Ze strany Kupujícího tvoří pracovní tým zejména pracovníci technického úseku (technický náměstek, vedoucí údržby, vedoucí oddělení zdravotnické techniky), přičemž osobou pověřenou v rámci tohoto centra ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Prodávajícím je František Kalina, BA (Hons), MSc. Ze strany Prodávajícího tvoří pracovní tým Ing. Petr Tampier, regionální manažer, přičemž osobou pověřenou v rámci tohoto týmu ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Kupujícím je paní Petra Šoltysová, koordinátor zakázek, tel. č. 377 590 444. Každá smluvní strana je oprávněna označit další osoby pověřené plněním jejich jednotlivých technických, provozních či organizačních úkolů. Jakoukoliv změnu ve složení těchto osob je každá smluvní strana povinna předem písemně oznámit druhé smluvní straně, aniž by se to považovalo za změnu této smlouvy.
- 16.4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze po jejich odsouhlasení příslušnými orgány obou smluvních stran a pouze formou dodatků podepsaných ze strany Kupujícího i Prodávajícího jejich statutárními orgány, popř. jinými orgány či osobami prokazatelně vybavenými písemnou plnou mocí a oprávněnými činit jménem nebo za příslušnou smluvní stranu takové právní jednání.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 17.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 17.3. Tato smlouva se uzavírá písemně a představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu této smlouvy.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 4. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu (č. 1 – Technická specifikace, č. 2 – Záruka a záruční podmínky, č. 3 – Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny, č. 4 – Doklad o pojištění). Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 17.5. Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a této smlouvy. Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějících částí smlouvy.

- 17.6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, přísluší o něm rozhodnout soudům.
- 17.7. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních smlouvy.
- 17.8. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 17.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.
- 17.10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 17.11. Ustanovení čl. 17.8., 17.9. a 17.10. této smlouvy se neuplatní, jestliže nebudou naplněny podmínky pro její zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.

Kupující:

V Třebíči dne 24. 11. 2017



Ing. Eva Tomášová
ředitel


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01

Prodávající:

V Praze dne 20. 11. 2017




Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva
CHEIRÓN a.s.

Cheirón 
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13 162 00 Praha 6
Prevozovna: Republikánská 1102 45, 312 00 Píseň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

věcně správně



Příloha č. 1

Technická specifikace


dle odstavce 3. 3. kupní smlouvy ze dne 24.11. 2017

viz. datasheety s technickými parametry:

- BENEHEART D1 PUBLIC
- BENEHEART D3

Kupující:

24. 11. 2017
V Třebíči dne _____ 2017




Ing. Eva Tomášová
ředitel
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01

Prodávající:

20-11-2017
V Praze dne _____ 2017



Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

CHEIRÓN a.s.

Cheirón 
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

9



BENEHEART D1 PUBLIC

AED

- JEDNODUCHÉ KROKY V NOUZOVÉ SITUACI
- RYCHLÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI DĚTSKÝMI A DOSPĚLÝMI PACIENTY
- MAXIMALIZACE VAŠICH INVESTIC

BENEHEART D1 PUBLIC

CHYTRÉ ŘEŠENÍ
MAXIMALIZUJÍCÍ
VAŠI INVESTICI

AED



- **Každý rok** postihne náhlá srdeční zástava (SCA) kolem 700 tisíc obyvatel v Evropě, 550 tisíc obyvatel v Číně, 360 tisíc obyvatel v USA a stovky tisíc dalších po celém světě.
- **SCA se může přihodit** komukoliv kdykoliv a kdekoliv. Mindray BeneHeart D1 defibrilátor umožňuje reagovat na SCA v různých místech. Může chránit studenty a učitele ve školách, lidi na pracovištích, cestující na letištích a sportovce během utkání a tréninku.
- **Lékařské statistiky z USA** ukazují, že počet lidí, kteří umírají na SCA je více než těch, kteří zemřou na 1 rakovinu prsu, rakovinu prostaty, AIDS, při požárech domů a dopravních nehodách.

- **Údaje z USA ukazují**, že každý den je téměř 1000 lidí postižených SCA Mimo nemocnici a pouze 10 % obětí přežije. Pokud je automatická externí defibrilace a KPR poskytnuta dříve, než přijede záchranná 1 služba, lze míru přežití zvýšit na 40 %.

VÝVOJ A ŘEŠENÍ PRO ZÁCHRANÁŘSKÉ TÝMY

Mindray BeneHeart D1 je vyvinut tak, aby jej mohli spolehlivě, jednoduše a snadno používat i laici.

- **7 palcový TFT displej** poskytuje srozumitelné instrukce s barevnými animacemi. Automatické nastavení hlasitosti a jasu displeje Vám umožní pohodlně používat D1 v různých prostředích. Předem připojené defibrilační elektrody šetří čas a pomocí konektoru elektrody lze automaticky identifikovat pacienta, takže je dětským pacientům dodávána nižší dávka energie.
- **Baterie bez možnosti** dobíjení s rozšířenou kapacitou umožňuje více než 300 výbojů po 200 J nebo 200 výbojů po 360 J a rovněž 12 hodin monitorování EKG.




BENEHEART D1 PUBLIC

AED


JEDNODUCHÉ KROKY V NOUZOVÉ SITUACI



1
Stisknutím zeleného tlačítka zapnete přístroj a aktivujete hlasové a vizuální instrukce.


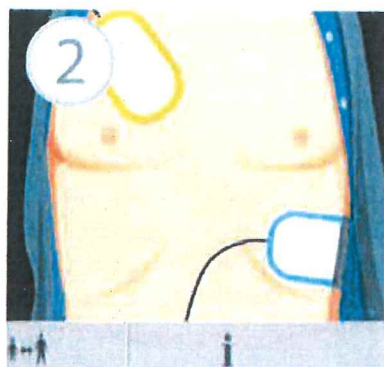


2
Umístěte elektrody na pacienta podle pokynů.

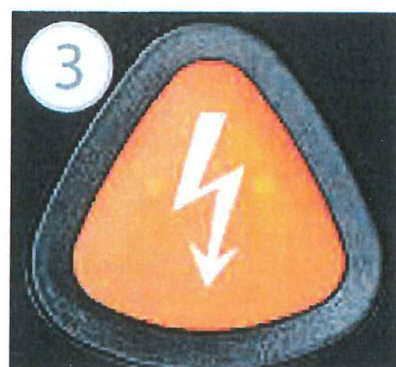

3
Když přístroj ohlásí výboj, stiskněte oranžové tlačítko.

RYCHLÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI DĚTSKÝMI A DOSPĚLÝMI PACIENTY

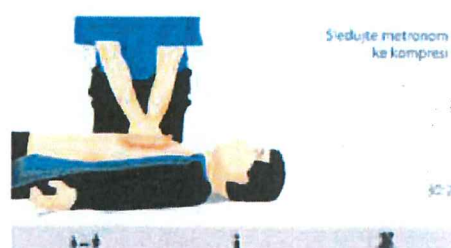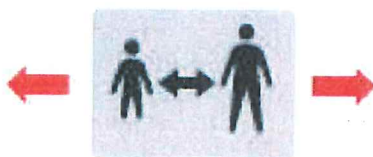

MAXIMALIZACE VAŠICH INVESTIC


Systém AED Alert je patentované řešení centrální správy, které umožňuje úsporu nákladů na servis a údržbu výrobku BeneHeart D1 instalovaného na veřejných místech, jako jsou nákupní centra, zábavní parky a firemní budovy.

TM AED Alert monitoruje stav jednotlivých AED pro zajištění pohotovostního režimu a správné funkce v případě potřeby. Údaje z D1 jsou přenášeny přes Wi-Fi * na server AED TM Alert, kde mohou být sledovány a spravovány servisním týmem.

Kromě toho předává server automaticky detaily veškerých technických problémů e-mailem odpovědnému servisnímu personálu.

- Sleduje denní stav každého AED (automatizovaného externího defibrilátoru)
- Zobrazuje a organizuje zkušební protokoly
- Kontroluje stanoviště každého AED (automatizovaného externího defibrilátoru)
- Vzdáleně aktualizuje BeneHeart D1

* Pro úsporu energie baterie přenáší D1 data pouze tehdy, když zapne svou automatickou kontrolu.

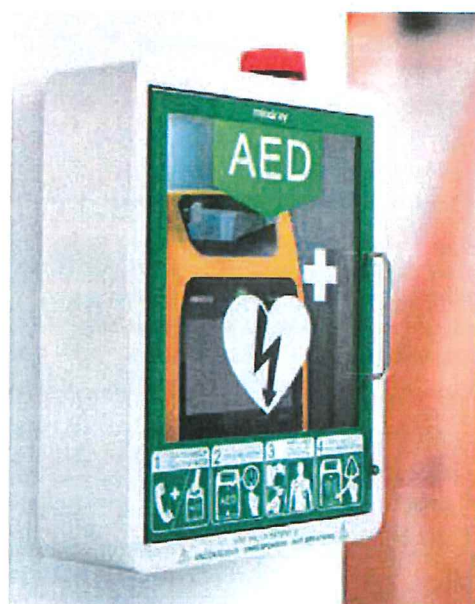

www.cheiron.eu

BENEHEART D1 PUBLIC

AED

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry

Rozměry	210 mm (š) x 286 mm (h) x 79,5 mm (v)
Hmotnost	
Main unit:	Pro: 2.3kg (without battery) Public: 2.2kg (without battery) Rechargeable battery: 0.50kg Disposable battery: 0.40kg

Požadavky na prostředí

Odolnost vůči vodě:	IPX5
Odolnost vůči pevným částicím:	IP5X
Teplota:	Provoz: 0 až 50 °C Skladování: -30 až +70 °C
Vlhkost:	Provoz / skladování: 5 až 95 %, bez kondenzace
Nadmořská výška:	Provoz / skladování: -381 m až +4575 m
Nárazy a vibrace:	Splňuje požadavky normy MIL-STD-810G, metoda 516.6 Splňuje požadavky normy MIL-STD-810G, metoda 514.6 Splňuje požadavky normy 6.3.4.2, EN1789 (Zdravotnické prostředky pro použití v silničních ambulancích).
Otřesy:	Splňuje požadavky normy 6.3.4.2, EN1789 (Zdravotnické prostředky pro použití v silničních ambulancích).
Volný pád:	Splňuje požadavky normy 6.3.4.3, EN1789 (výška pádu: 0,75 m). Splňuje požadavky normy IEC60068-2-32 (výška pádu: 1,5 m). Splňuje požadavky normy EN/IEC 60601-1.
Bezpečnost:	

Displej

Typ:	Barevný TFT LCD
Rozměry:	7 palců
Rozlišení:	800 x 480 pixelů
Zobrazení vln:	1 kanál
Doba zobrazení vlny:	6 s

Napájení

Jednorázová baterie

Typ:	Li/MnO2
Počet:	1
Kapacita (nová plně nabitá baterie):	Minimálně 300 výbojů 200 J nebo 200 výbojů 360 J
Skladovací doba (před vložením):	Minimálně 5 let od data výroby
Pohotovostní režim (po vložení):	Obvykle 4 roky

Elektrody

Aktivní plocha povrchu:	8 cm² každá 43 cm² každá
Délka kabelu:	210 +10 cm
Datum spotřeby:	3 roky od data výroby

Ukládání dat

Profil pacientů:	Max. 100 pacientů
Události:	až 1000 událostí
Uložení vln:	Až 8 souvislé vlny EKG
Hlasový záznam:	Max. 3 hodiny
Export dat:	Data lze exportovat do počítače pomocí paměti USB flash

Defibrilátor

Vlna:	Bifázická zkrácená exponenciální vlna s kompenzací impedance
Energetická přesnost:	2 J nebo 15 % z nastavení, podle toho, která hodnota je vyšší, při 50 Ohm.
Dodání impulsu:	Prostřednictvím multifunkčních defibrilačních elektrod
Rozsah impedance pacienta:	25 až 200 Ohm

Ruční režim (pro jednotku Pro)

Výstupní energie:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 J
Doba dobíjení:	Méně než 5 s na 200 J s novou plně nabitou baterií Méně než 8 s na 360 J s novou plně nabitou baterií
Synchronní kardioverze:	Přenos energie je zahájen do 60 ms od vrcholu QRS

Režim AED

Výstupní energie:	Konfigurovatelná uživatelem.
Řada impulsů AED:	Úroveň energie pro dospělé: 100 až 360 J, konfigurovatelná
Úroveň energie pro novorozence /	10 až 100 J, konfigurovatelná
Řada impulsů:	1, 2, 3, konfigurovatelná
Výchozí konfigurace odpovídá pokynům 2010 AHA. Doba přípravy prvního impulsu: (elektrody jsou připojeny k pacientovi, zařízení je zapnuté a počáteční zjištění rytmu odpovídá doporučení impulsu)	

Méně než 10 s na 200 J
Méně než 17 s na 360 J
(jednorázová baterie pro jednotku Public)
Méně než 10 s na 360 J (dobíjecí baterie pro jednotku Pro)

Citlivost a specifická:	Splňuje požadavky normy AAMI DF 80.
-------------------------	-------------------------------------

Automatické a uživatelem aktivované samočinné testy

Každodenní automatické testy:	Test vnitřních obvodů, systému nabíjení / dodávky výbojů, elektrod a nabití baterie
-------------------------------	--

Vložení baterie / uživatel

Testy:	Po vložení baterie je připravenost zařízení zkontrolována, prostřednictvím rozsáhlých samočinných a uživatelem řízených testů.
--------	--

Indikátory stavu:	Blikající zelený indikátor znamená připravenost k použití. Blikající červený indikátor nebo zvukový signál znamenají nutnost provedení údržby.
-------------------	---



Cheirón
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, BRNO mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, KROMĚŘÍŽ mobil: 725 714 941, OSTRAVA mobil: 728 564 509

www.cheiron.eu





BENEHEART D3

VÝKONNÉ FUNKCE PRO RŮZNÉ APLIKACE

- KOMPAKTNÍ, LEHKÝ DEFIBRILÁTOR S MANUÁLNÍ DEFIBRILACÍ
- KVALITNÍ MONITORING VITÁLNÍCH FUNKCÍ: EKG, NIBP, SPO2 A RESPIRACE
- IP44 OCHRANA PŘED VODOU A PRACHEM

BENEHEART D3

VÝKONNÉ FUNKCE PRO RŮZNÉ APLIKACE

LEHKÝ DEFIBRILÁTOR S MANUÁLNÍ DEFIBRILACÍ

BeneHeart D3 je kompaktní, lehký defibrilátor s manuální defibrilací, AED módem, monitoringem, kardiostimulátorem a funkcemi AED. Rychlé nabíjení a cyklus podání výboje zajišťuje


efektivní resuscitaci. Kvalitní monitoring vitálních funkcí: EKG, NIBP, SPO2 a respirace, může zlepšit kvalitu diagnózy a rychle indikovat efektivní defibrilaci.

2 Referenčních 120s




Zmrazení referenčních křivek posledních 120 s EKG křivek zajišťuje rozšířené odhalení abnormálních signálů. Speciální nástroje pomáhají lékařům vyhodnotit potenciální riziko výskytu srdečních arytmií

3 Vysoce kontrastní displej

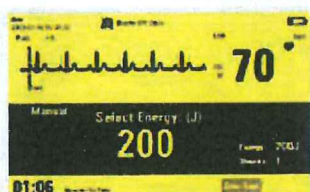


Vysoce kontrastní displej zajišťuje jednoduché sledování během vysokého / silného osvětlení, speciálně ve venkovních podmínkách.

4 Menu

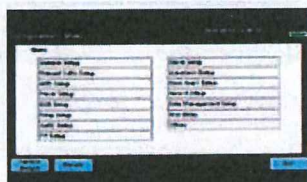

Centrální nastavení defibrilace a monitoringu na jedné stránce, jednoduché nastavení všech konfigurací v jednom čase

5 Ukládání dat

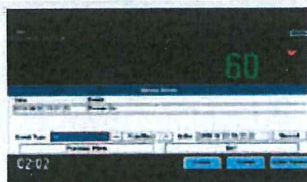

Výkonné ukládání dat včetně 100 patientských profilů, 1000 událostí pro každého pacienta a 24 hodin nepřetržitých křivek EKG uspokojuje lékařské profesionály v případech analýz, klinických statistik a požadavků papírového průzkumu

BENEHEART D3

VÝKONNÉ FUNKCE PRO RŮZNÉ APLIKACE

IP44 ochrana před vodou a prachem na profesionální úrovni zaručuje použití ve všech vhodných klinických prostředích.


1 Monitoring




Široký displej s vysokým rozlišením se 3 kanály / křivkami zobrazuje kontinuálně informace o monitoringu EKG, NIBP a SPO2



6 Software datového managementu

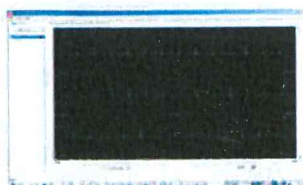


Uživatel může prohlížet patientská data, události a křivky EKG, editovat patientská data a tisknout zprávy na počítači pomocí software datového managementu

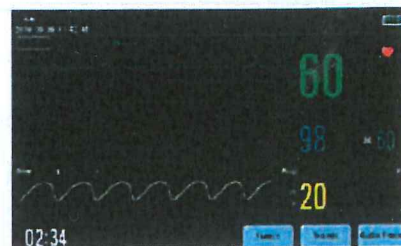


Monitoring

Diagnostická kvalita měření a monitoring včetně 3/5 svodového EKG, Mindray / Masimo / Nellcor SpO2

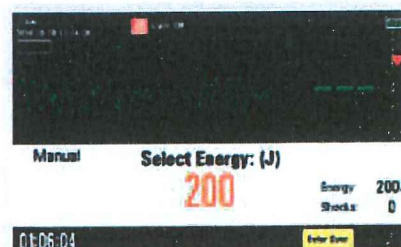


Manuální defibrilace

Režim asynchronní defibrilace pro kardioverzi ventrikulární fibrilace
Režim synchronní defibrilace pro kardioverzi fibrilace síní

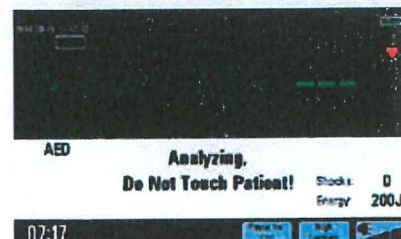

AED

V režimu AED, defibrilátor / monitor automaticky analyzuje rytmus a určuje, zda podat výboj. Hlasové a textové povely provádí uživatele celým procesem. Je možný 180 minutový hlasový záznam, dostupný pro pozdější analýzu a hodnocení

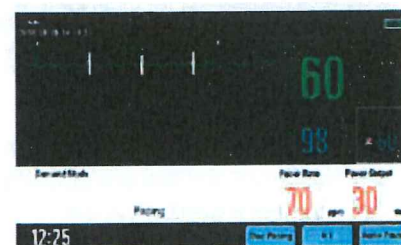

Neinvasivní kardiostimulace

BeneHeart nabízí dva režimy neinvasivní kardiostimulace: demand mód a fixed (fixní) mód s nastavitelnými dávkami a výstupem. Tlačítko 4:1 může dočasně omezit kardiostimulační puls na 1/4 definované kardiostimulační dávky a sleduje pacientův základní rytmus, aby zabránilo riziku způsobeného náhlým poklesem srdečního rytmu

BENEHEART D3


VÝKONNÉ FUNKCE PRO RŮZNÉ APLIKACE

Páidla




Externí páidla lze rychle změnit z dospělých na dětské odejmutím horní části páidel

Elektrody

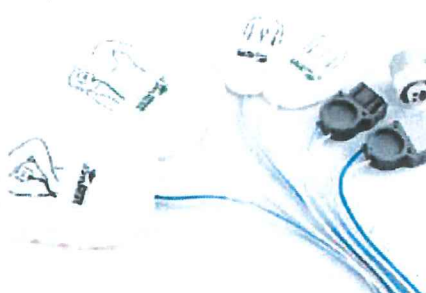

Dospělé a dětské multifunkční defibrilační elektrody určené pro defibrilaci nebo stimulaci

Brašna na příslušenství

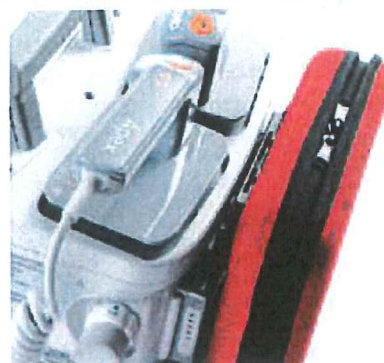

Volitelná brašna na příslušenství je připevněna na zadní straně přístroje pro uložení příslušenství a je jednoduché ji podle potřeb odejmout

Držák gelu



Držák tuby s gelem na zadní straně přístroje pro rychlé použití

Přenosná rukojeť (madlo)



Robustní rukojeť (madlo) má vytvořený design pro snadné přenášení během transportu

Nabíječka baterií



Nabíječka pro dvě baterie je kompatibilní s bateriemi obou BeneHeart defibrilátorů – D6 a D3

- Velký displej a barevně rozlišená tlačítka zjednodušují ovládání defibrilátoru pouze ve 1-2-3 krocích
- Veliký indikátor alarmu rychle upoutá pozornost a informuje promptně o pacientově stavu, pro zlepšení péče o pacienta
- Ovládací tlačítka na pádlech nastavují výboj rychle a jednoduše – tlačítka pro pohodlnou volbu energie, nabíjení a podání výboje

- Otočné navigační kolečko je velmi pohodlným vstupem do menu přístroje – navigace na obrazovce jednoduchým otáčením a stlačováním
- Tlačítko pro výběr svodu zajišťuje rychlý vstup pro zobrazení optimální EKG křivky
- Vícenásobný síťový napáječ, AC / DC / vstup 12 V DC, to vše umožňuje pracovat s přístroji na jakémkoliv místě

BENEHEART D3

DEFIBRILÁTOR S MANUÁLNÍ DEFIBRILACÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Fyzikální

Rozměry

288 mm () x 203 mm () x 275 mm ()

Hmotnost hlavní jednotky

4,7 kg (včetně EKG / defibrilátoru / kardiostimulace / SpO2 / respirace)

Balení baterie (kus)

0,5 kg

Externí pádla, set

0,8 kg

Vnější a fyzikální požadavky

Odolnost vůči vodě:

IPX4 (bez externího napáječe)

Odolnost vůči prachu:

IPX1 (s externím napáječem)

Teplota:

IP3X

Provozní: 0 – 45 °C

Vlhkost:

Ukládání: - 30 °C až 70 °C

Nadmořská výška:

Provozní / skladovací: 10 až 95 %, nekondenzující

Vibrace:

Provozní / skladovací: -381 m až +4575 m

Nárazy:

Splňuje požadavky 21.102, ISO 9919 (Vibrace pro transport)

Volný pád:

Splňuje požadavky 6.3.4.2, EN 1789 (Zdravotnické zařízení, pro použití v sanitních vozidlech)

EMC (elektromagnetická snášenlivost)

Splňuje požadavky 6.4.2 EN 1789 (Výška pádu 0,75 m)

Bezpečnost

Splňuje požadavky IEC 60601-1-2

Splňuje požadavky EN/IEC 60601-1

Displej

Typ:

TFT barevný LCD

Rozměr:

7"

Rozlišení:

800 x 480 pixelů

Křivky displeje:

max. 3 kanály

Čas zobrazení křivky:

max. 16 s (EKG)

Napájení

Zdroj střídavého napájení

Síťové napájení:

100 až 240 V střídavého napětí ($\pm 10\%$)

Proud:

1,8 a 0,8 A

Frekvence:

50/60 Hz (± 3 Hz)

Zdroj stejnosměrného napájení

Vstupní napětí:

12 V DC

Příkon:

190 W

Baterie

Typ:

3 Ah, 14,8 V, dobíjitelná lithium-ionová baterie – sada

Počet:

1

Doba nabíjení:

méně než 2 hodiny na 80 % a méně než 3 hodiny na 100 %, je-li přístroj vypnutý.

Indikátor kapacity:

5 dílný LED indikátor pro rychlou informaci o stavu baterie

Kapacita:

(nová, plně nabitá baterie):

Monitorační režim:

2,5 hodin, kontinuální monitoring EKG, SpO2, se všemi propojenými kabely / snímači

Defibrilační režim:

100x, 360 J vybití v intervalech 1 minuty, bez záznamu.

Kardiostimulační režim:

2 hodiny, 50 Ohm zatěžovací impedance, kardiostimulační rychlost: 80 bpm, kardiostimulační výstup: 60 mA

Tiskárna

Metoda:

Termální tisk s vysokým rozlišením

Křivky:

max. 3 kanály

Rychlost:

25 mm/s, 50 mm/s

Šířka papíru:

50 mm

Zprávy:

Následující zprávy mohou být zaznamenány: přehled událostí, tabulkové trendy, zmrazené křivky, souhrn, operační kontrola a konfigurace

Auto záznam:

Tiskárna může být nastavena tak, aby vytiskla označené události, nabití, výboje a alarmy.

Uložení dat

Pacientské profily:

max. 100 pacientů

Události:

do 1000 událostí u jednoho pacienta

Uložení křivek:

do 24 hodin nepřetržitého záznamu EKG křivky

Tabulární trendy:

72 hodin, rozlišení 1 min.

Hlasový záznam:

Max. 180 min. celkem, max. 60 min. pro jednotlivého pacienta

Export dat:

Data mohou být exportována do počítače pomocí USB.

Defibrilace

Křivka:

Bifázická pravouhlá exponenciální křivka (BTE) s kompenzací impedance

Přesnost energie:

± 2 J nebo 15 % nastavení, podle toho, co je větší, do 50 Ohmů

Doba nabití:

Méně než 5 sekund na 200 J s novou, plně nabitou baterií.

Méně než 8 sekund na 360 J s novou, plně nabitou baterií.

Podání výboje:

Pomocí multifunkčních defibrilačních nalepovacích elektrod nebo pádel.

Rozsah pacientské impedance:

20 až 200 Ohmů (externí defibrilace)

BENEHEART D3

DEFIBRILÁTOR S MANUÁLNÍ DEFIBRILACÍ

Manuální mód

Výstupní energie:

Synchronní kardioverze:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 J

Přenos energie začíná během 60 ms od QRS peak.

Přenos energie začíná během 25 ms od externího synchronního pulsu.

AED mód

Výstupní energie:

Série AED výbojů:

Nastavitelná uživatelem

Úroveň energie: 100 až 360 J, nastavitelná

Série výbojů: 1, 2, 3, nastavitelná

Standardní nastavení odpovídá směrnici AHA 2010

Citlivost a přesnost odpovídá AAMI DF-80.

Neinvazivní kardiostimulace

Křivka:

Šířka pulsu:

Perioda odporu:

Režim kardiostimulace:

Rychlost kardiostimulace:

Výstup kardiostimulace:

Kardiostimulace 1:4

Monofázická čtvercová pulsní křivka

20 ms, $\pm 5\%$

200 až 300 ms, $\pm 3\%$ (funkce poměru)

demand nebo fix

40 ppm až 170 ppm, $\pm 1,5\%$

0 mA až 200 mA, $\pm 5\%$ nebo 5 mA, podle toho, co je větší

Kardiostimulační pulsní frekvence je redukována faktorem 4, je-li toto aktivováno.

EKG monitoring

Svody:

Výběr svodů:

Zobrazení srdeční frekvence:

3svodové EKG, 5svodové EKG, elektrody / pádla

I, II, III, aVR, aVL, V, elektrody / pádla

Dospělí:

Děti:

Novorozenci:

1 t/min

ano

ano

2,5 mm/mV (x 0,25); 5 mm/mV (x 0,5); 10 mm/mV (x 1); 20 mm/mV (x 2); 40 mm/mV (x 4)

12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s

Přesnost:

Arytmie:

Alarmy:

EKG rozměry:

Rychlost posuvu křivek:

Ochrana pacienta (izolace) (defibrilační test):

Typ CF: EKG, resp., teplota, SpO2

Typ BF: externí defibrilace

Respirace

Metoda:

Rozsah:

Přesnost:

měření hrudní impedance

Dospělí: 0 až 120 d/min

Děti, novorozenci: 0 až 150 d/min

1 d/min

SpO2, pulsní oxymetrie

Mindray SpO2

Rozsah:

Přesnost:

Tepová frekvence:

Masimo SpO2

Rozsah:

Přesnost:

Tepová frekvence:

Nellcor SpO2

Rozsah:

Přesnost:

Tepová frekvence:

0 až 100 %

1 %

20 až 254 t/min

1 až 100 %

1 %

25 až 240 t/min

1 až 100 %

1 %

20 až 300 t/min



Cheirón®
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941

www.cheiron.eu



CH-06-04-150120-BeneheartD3

Příloha č. 2

Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy ze dne 24.11. 2017

1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti i příslušenství plnou záruku po dobu **24 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“). Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy (Zařízení) vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy.
2. Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení:

- **v případě nefunkčnosti zdravotnických technologií a vybavení, které jsou nezbytné k zajištění provozu oddělení** do 48 hodin nahlášení opravy (viz odst. 3.), v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není zhotovitel v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 72 hodin počítaných od nahlášení opravy.
- **v případě nefunkčnosti zdravotnických technologií a vybavení, které nejsou nezbytné k zajištění provozu oddělení** do 72 hodin nahlášení opravy (viz odst. 3.), v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není zhotovitel v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 10 pracovních dní počítaných od nahlášení opravy.

V případě sporu smluvních stran o stanovení zdravotnických technologií a vybavení jako „nezbytného k zajištění provozu oddělení“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

3. Prodávající musí závadu odstranit a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2. této Přílohy č. 2. Prodávající splní svůj závazek k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25% z pořizovací ceny konkrétního zařízení, jehož se závada týká a to za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy na ni vzniknul Kupujícímu nárok.
4. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.
5. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.

6. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit zhotoviteli prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 377 590 455, 419 nebo e-mailem na adresu: servis@cheiron.eu.

Pracovní doba prodávajícího je od 6.30 hodin do 15.00 hodin.

Za okamžik nahlášení považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Kupující:

24. 11. 2017

V Třebíči dne _____ 2017



Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01

Prodávající:

20. 11. 2017

V Praze dne _____ 2017



Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva
CHEIRÓN a.s.

Cheirón 
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna, Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

9

Příloha č. 3

Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny

dle odstavce 6. 2. kupní smlouvy ze dne ____ 2017

Příloha č. 3 smlouvy - Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny

Číslo dílního plnění	Číslo položky	Název	MJ	Počet / ks				DPH	Cena / ks	Cena s DPH / ks	Cena bez DPH / kusy	Cena s DPH / kusy
				I. etapa (PCHO)	II. etapa (O)	II. etapa (G)	celkem					
3	143106	defibrilátor automatický	ks	5	1	3	9	21	31 720,00 Kč	38 381,20 Kč	285 480,00 Kč	345 430,80 Kč
3	143107	defibrilátor, monitor (bifazický, monitorace, SpO2, EKG, TK - mŕže)	ks	4	2		6	21	143 527,00 Kč	173 667,67 Kč	861 162,00 Kč	1 042 006,02 Kč
3	143108	defibrilátor bifazický (dětská, dospělá pádla, zevní kardiostimulace)	ks		1		1	21	143 527,00 Kč	173 667,67 Kč	143 527,00 Kč	173 667,67 Kč
Celková cena											1 290 169,00 Kč	1 561 104,49 Kč

Legenda:

I. etapa: budova PCHO - předběžně dle harmonogramu do 9/2017

II. etapa: budovy O a G - předběžně dle harmonogramu do 3/2018



VIENNA INSURANCE GROUP

Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G.

Agentura Západní Čechy
Zahradní 3
326 00 Plzeň
ústředna-tel.: 377 417 111
ústředna-fax: 377 417 888
bezplatná linka: 841 105 105

e-mail: hsykorova@koop.cz
tel.: 377 417 113
fax: 377 417 888
www.koop.cz

CHEIRÓN a.s.
Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Váš dopis značka/ze dne

naše značka (uvedte v odpovědi)

vyřizuje/linka

v Plzni dne

Hana Sýkorová

11.12.2014

Věc: Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu


Potvrzujeme tímto, že klient **CHEIRÓN a.s.**, IČ 270 94 987, se sídlem Ulrychova 2260/13, Praha má pojistnou smlouvou č. **7720783190**, **dodatek č. 2** sjednané pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku v následujícím rozsahu:

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP3, DODP5 Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čistě finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění (1201)					
Poř. Číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁽⁶⁾	Sublimit pojistného plnění ⁽⁷⁾	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Územní platnost pojištění
1	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění, DODP2	ČR: 40 000 000,- Kč, svět mimo ČR,USA a Kanady: sublimit pojistného plnění 25 000 000,- Kč	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	ČR: obecná: 20 000,- Kč ČR: výrobek: 50 000,- Kč Svět mimo ČR,USA a Kanady: 50 000,- Kč	Celý svět mimo USA a Kanady
2	Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění, DODP3	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	1 000 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
3	Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění, DODP5	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	300 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
4	Čistě finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	300 000 Kč	10% min. 10 000 Kč	Česká republika

Pojištění je sjednáno na dobu od 01.10.2014 na dobu neurčitou.

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

Ing. Bronislava Pokorná
vedoucí referátu



Hana Sýkorová
underwriter specialista